Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie *est une approche holistique par laquelle tout être humain peut découvrir, à l'aide de la* ***méthode scientifique expérimentale,*** *les paramètres de l'onde RHUMART® qui lui permettent d'améliorer sa santé et son bien-être en utilisant l'unique Conditionneur RESC™*

GUIDE D'EMPLOI

du

Conditionneur RESC™

Modèle Auto-Santé™

Dr R.A. DROLET, PH.D.

Le Conditionneur RESC™
Modèle AUTO-SANTÉ™ De Luxe

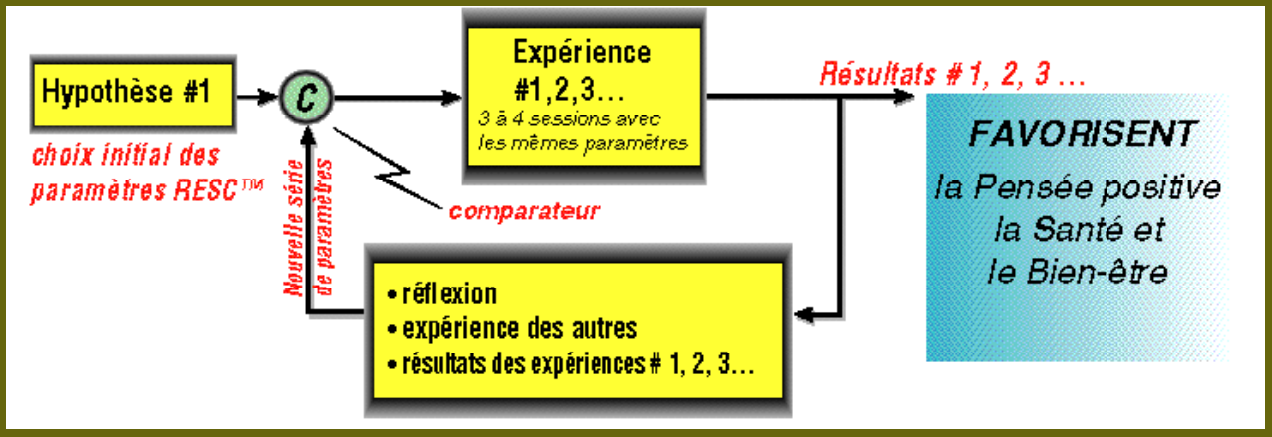

La Méthode Scientifique Expérimentale

appliquée au Conditionnement RESC™

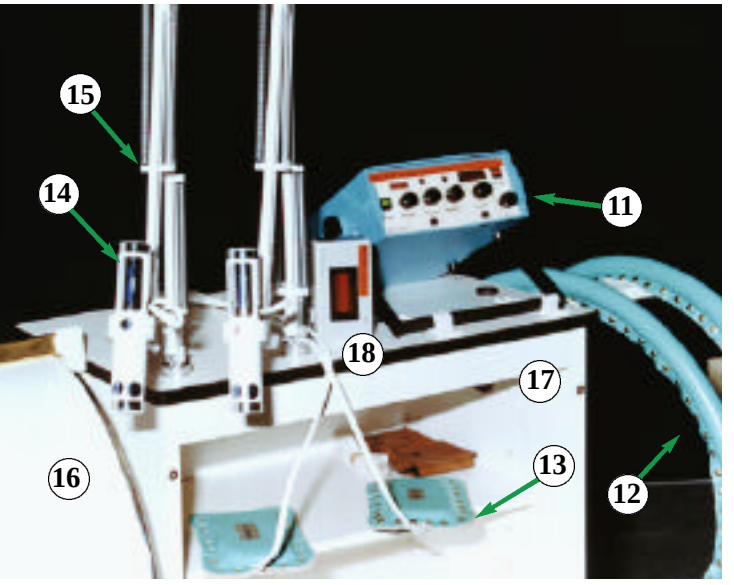

Le Conditionneur RESC™

(De Luxe, AUTO-SANTÉ™, pour couples)

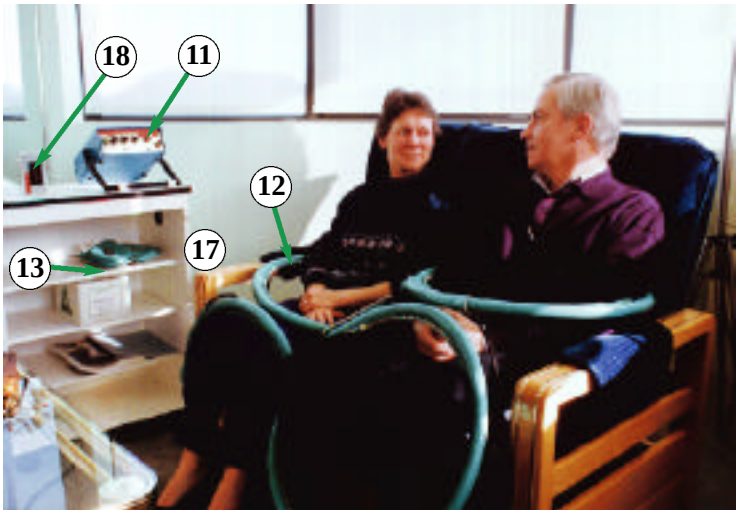

Légende

(11) MBI-3000, Contrôleur RESC™
(12) MAXI-2A, paire d'anneaux
(13) REBONE-4A, applicateurs régionaux
(14) MINI-4A, applicateurs locaux
(15) BF-2, bras flexibles
(16) MAXI, applicateur global
(17) Table RHUMART®
(18) MBI-101, détecteur de champ (optionnel)

RESC™ est une **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE**™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART®.
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE** sont des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, **L'institut RHUMART® international (iRi)**, Qc, Canada, janvier 1991.

Photo du Dr Drolet différente de celle de La Presse

Selon l'inventeur du système Auto-Santé™ RHUMART® et détenteur d'un doctorat en génie biomédical, Roland A. Drolet, les nombreux témoignages enthousiastes qu'il reçoit sont aussi valables que n'importe quelle recherche scientifique.

Des commentaires positifs sur les appareils à champs magnétiques

DANIELLE BONNEAU

■ Après avoir lu le dossier sur les appareils à champs magnétiques, publié la semaine dernière, quelques lecteurs ont appelé pour dire qu'ils possèdent un de ces appareils et s'en portent mieux.

Selon les propos recueillis par Santé et Bien-Être Social Canada et des professionnels de la santé, il existe peu de preuves scientifiques de leur efficacité.

Mais Jacques Matte, un homme d'affaires qui avait des bursites qui l'empêchaient de dormir depuis 1976, dit se sentir remarquablement bien depuis qu'il a commencé à utiliser l'appareil RHUMART®, en mars dernier.

«**La machine a des effets anti-inflammatoires extraordinaires, affirme-t-il. Mes migraines ont disparu, je peux maintenant jouer au tennis, je dors mieux, donc je suis reposé et cela a un effet sur mon caractère**. Je trouve cela formidable de ne plus avoir de douleur!

«J'utilise l'appareil trois fois par semaine, pendant cinq minutes, a-t-il ajouté. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a soulagé. C'est peut-être une béquille, mais quand on a juste une jambe, cela fait du bien. **J'avais tout essayé, puis c'est arrivé. C'est la dernière chose qu'on m'enlèverait**.»

Un doctorat

Roland A. Drolet, qui a obtenu un doctorat en génie biomédical à l'Université de Toronto, en 1971, est l'inventeur du système Auto-Santé™ RHUMART® et président de la compagnie Médecine Bioélectrique Inc. (MBI).

Selon lui, les impulsions bioélectriques émises par l'appareil RHUMART® ressemblent étroitement à celles du système nerveux.

«**Les impulsions aident les gens à se guérir en produisant trois effets physiologiques qui sont les mêmes que ceux produits par l'exercice physique et la marche**, explique-t-il. Ainsi, **la circulation sanguine s'améliore et il se produit une certaine relaxation qui entraîne des effets anti-douleur et anti-inflammatoire. Comme le sang circule mieux, cela stimule la réparation et la régénération cellulaire**.

«Quand on n'a pas fait d'exercice depuis un bon bout de temps, on ankylose et on développe, par exemple, des douleurs rhumatismales, de l'arthrite, précise-t-il. On a mal, on est trop gros, donc on n'est plus capable de faire de l'exercice. C'est un cercle vicieux. Or l'exercice physique est fondamental pour demeurer en forme.

«Les trois effets produits par le RHUMART® jouent un rôle similaire et **renforcent le système d'auto-défense**, qui peut mieux protéger l'organisme contre toutes sortes de petits problèmes de santé. **La douleur ayant diminué, les gens peuvent à nouveau faire de l'exercice**, ils sont plus relaxés, donc ils dorment mieux la nuit. Ils se sentent tellement mieux qu'ils peuvent à nouveau croire en leur corps.

«**La pensé positive est très importante**, poursuit-il. **On ne dit pas que les appareils guérissent des maladies. On croit plutôt qu'ils aident les gens à améliorer leur santé**.»

À 5 000 $ l'unité

Quelque 4 000 familles ont fait l'acquisition des appareils RHUMART®, qui se vendent environ 5 000 $, souligne-t-il. **Et les nombreux témoignages enthousiastes qu'il reçoit sont aussi valables que n'importe quelle recherche scientifique**, estime-t-il. Lors d'assemblées, de nombreux utilisateurs satisfaits s'empressent d'ailleurs de livrer leurs commentaires.

Selon M. Drolet, **le RHUMART® ne doit pas être considéré comme un appareil médical et doit rester entre les mains des utilisateurs**.

«**Les individus sont les mieux placés pour adapter les paramètres à leurs besoins**, soutient-il. C'est comme l'exercice physique. **En se basant sur la réaction de leur corps**, les gens peuvent adapter la durée et l'intensité des impulsions.»

Source:

La Presse, Montréal, mercredi 27 février 1991, page C4.
L'article de La Presse a été reproduit intégralement, sauf que la photo du Dr Drolet a été remplacée par une photo couleur et les marques de commerce Auto-Santé™ et RHUMART® ont été indiquées par les lettres ® et ™.

PRÉFACE

Toutes mes félicitations pour votre décision de vous prendre en main par l'acquisition du moyen le plus subtil et le plus efficace pour vous aider à contrôler votre santé et votre joie de vivre. J'ai parlé de votre **Conditionneur RESC™**, ou mieux encore, de votre Système **Anti-Stress-RHUMART®**.

Ce système unique au monde vous permet d'améliorer la perception mentale de votre corps, le rendant plus relaxé et plus résistant à toute perturbation. Il vous aide à redécouvrir **la Confiance en Soi** d'où découle la **pensée positive**, condition essentielle pour recouvrer la santé et le bien-être perdus à la suite de divers problèmes de santé physique et/ou mentale.

Je tiens à vous rappeler que **le Conditionneur RESC™ n'est en aucune façon un appareil médical** et encore moins un appareil de diagnostic ou de traitement d'une maladie ou d'un problème de santé en particulier.

En fait, **ce conditionneur renforce le système immunitaire naturel d'autodéfense et de guérison, lequel aide à combattre le stress physiologique relié à la plupart des problèmes de santé**. (Voir l'*Annexe-A* pour détails)

Dr Roland A. Drolet, Ph.D.

GUIDE D'EMPLOI

du

Conditionneur RESC™

Modèle Auto-Santé™

ou la

Méthode Scientifique Expérimentale

fondée sur

L'Auto-détermination
et
L'Expérimentation

pour améliorer

La Pensée positive
La Santé
et le
Bien-être intérieur

par le

Dr Roland A. Drolet, Ph.D.

Directeur-Fondateur

de

L'institut RHUMART® international (iRi)

© Droits d'auteur, L' institut RHUMART® international (iRi),
Janvier 1991, Québec, Canada

MOTIVATION
de l'expérimentateur RESC™

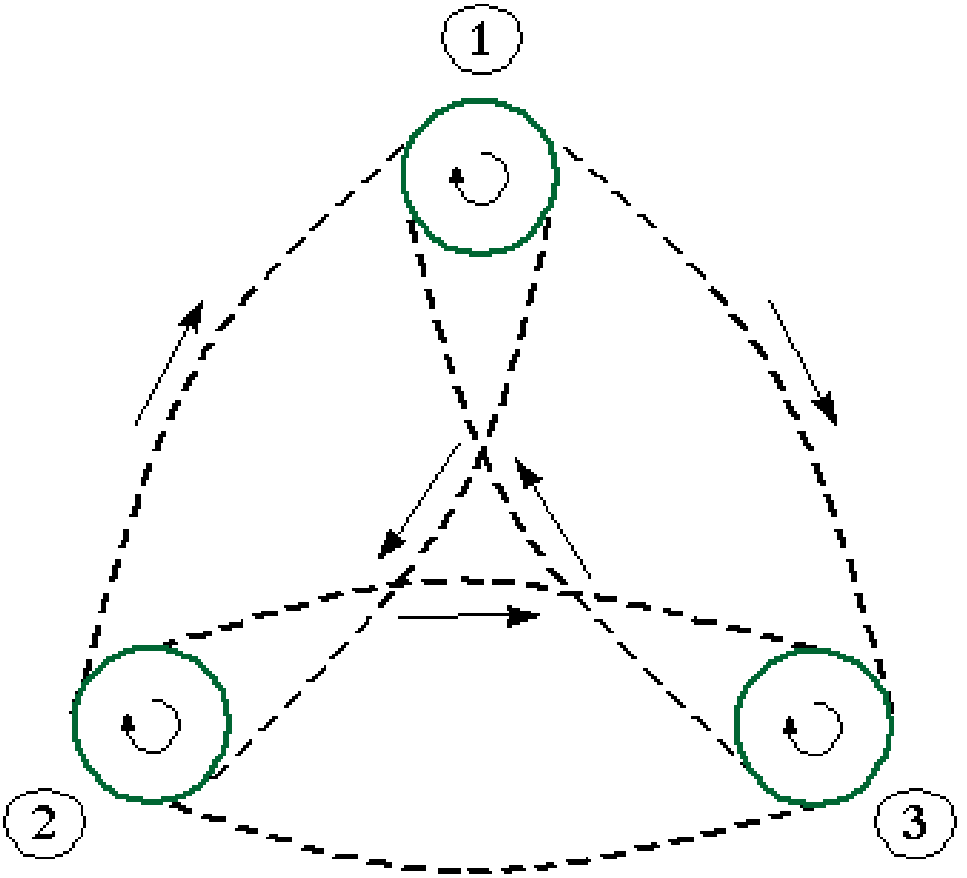

CONSEILLER
professeur ou
mentor

conditionneur
RESC™

Table des Matières

Préface …4

Introduction …9

I. **Le RESC™, *Philosophie-Scientifique$_{TM}$ de la Vie -I-*** …11

II. **Le RESC™, *Philosophie-Scientifique$_{TM}$ de la Vie -II-***

Comment et pourquoi le conditionnement RESC™ peut vous aider à

PENSER positivement,
AMÉLIORER votre SANTÉ et
PARVENIR à un BONHEUR durable …15

III. **La Méthode Scientifique Expérimentale appliquée au RESC™ et le Schéma de l'Homme** …32

IV. **Les Conditionneurs RESC™ et leur utilisation** …39

- Composantes des deux modèles de conditionneur RESC™ …41
- Précautions et avis sur l'efficacité et la sécurité du RESC™ …46
- **MBI-3000:** Mise en marche et contrôle de qualité …49
- **MBI-3000:** Programmation et applications …53

V. **Guide d'emploi abrégé**: modèle AUTO-SANTÉ™ et exemples de **positionnement des applicateurs** …59

VI. **Spécifications techniques et énergétiques** …77

Annexe-A : **CLASSIFICATION non-médicale** du Conditionneur RESC™ …83

Annexe-B : **Les 3 "faux-problèmes"** les plus fréquents …87

Annexe-C : **Garantie du Manufacturier** …88

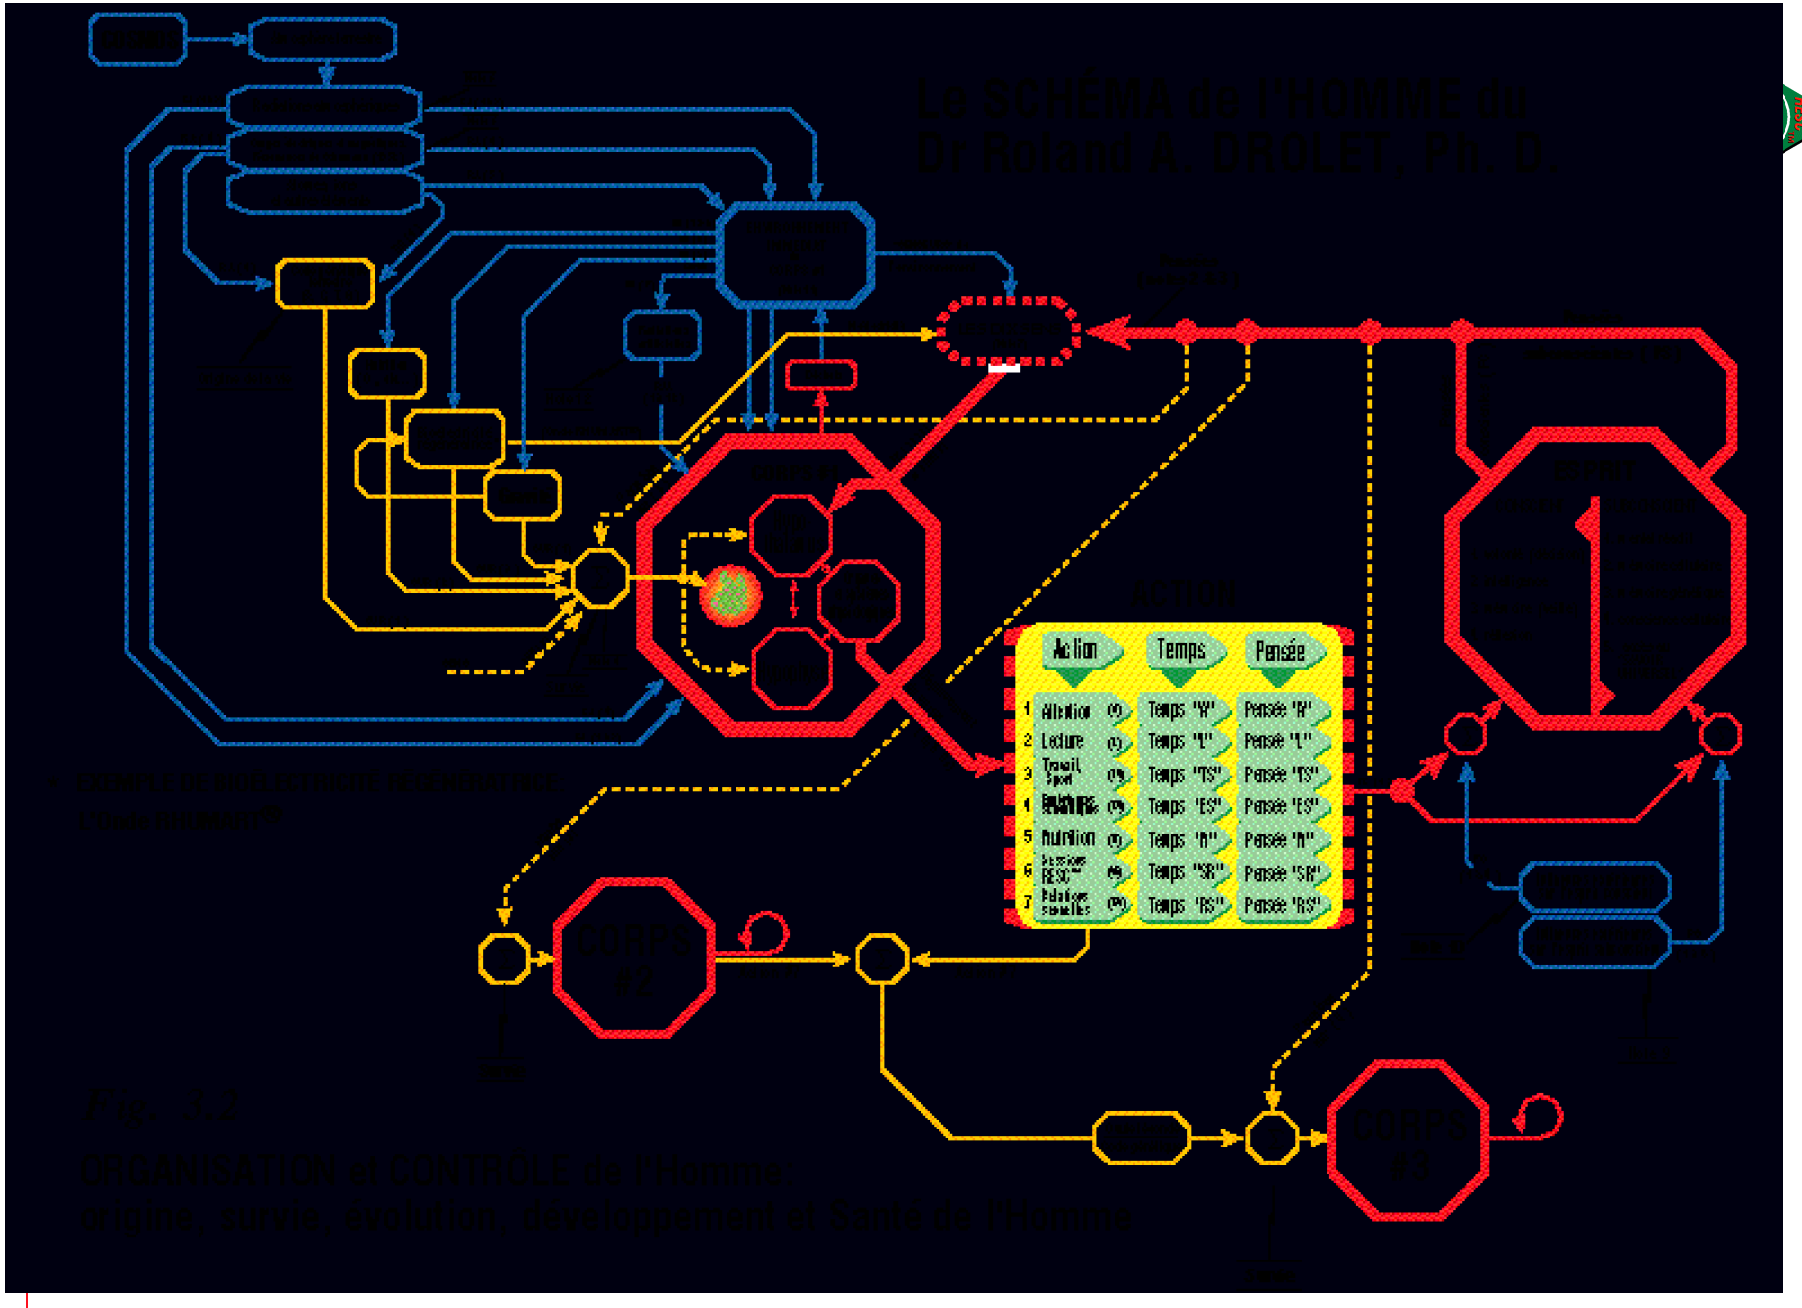

Fig. 3.2

ORGANISATION et CONTRÔLE de l'Homme:
origine, survie, évolution, développement et Santé de l'Homme

Le concept RHUMART® c'est bien plus qu'un appareil, c'est une Philosophie-Scientifique™ de la Vie.

Introduction au:

GUIDE D'EMPLOI

du Conditionneur RESC™

et à la

Philosophie-Scientifique™ de la Vie

Cette philosophie est une approche holistique par laquelle tout être humain peut découvrir à l'aide de la **méthode scientifique expérimentale**, les paramètres (amplitude, durée et modulation) de l'onde RHUMART® qui lui permettent d'améliorer sa santé et son bien-être en utilisant l'unique Conditionneur RESC™.

Le principe de fonctionnement du "phénomène RESC™" est le suivant. Avec **les effets physiologiques** induits par le Conditionneur RESC™, l'expérimentateur améliore la perception mentale de son corps. Il redécouvre **la Confiance en Soi**, d'où découle **la pensée positive** qui l'aide à améliorer sa Santé et son Bien-Être.

La *Section-I* représente une brève synthèse de la **philosophie RESC™**.

La *Section-II* vous fait découvrir que **les Pensées sont des entités physiques** qui contrôlent votre vie ainsi que les trois étapes fondamentales d'apprentissage qui vous permettront de découvrir **Votre** vérité dans tous les domaines qui vous intéressent. Vous y découvrirez également comment **le Conditionneur RESC™ peut vous aider à élever votre niveau de conscience,** condition essentielle pour parvenir à un bonheur durable.

La *Section-III* vous enseigne **la méthode scientifique expérimentale** appliquée au RESC™ et vous y découvrirez le lien entre cette méthode et les **Cycles-d'Action-Positive** dont le concept est illustré à l'aide du **Schéma de l'Homme** du Dr Roland A. Drolet, Ph.D.

La *Section-IV* constitue le **Guide d'Emploi officiel** spécifique aux Conditionneurs RESC™. Vous devez lire cette section avec les Fig. 4.1, 4.3 et 4.4 en main (carton plastifié). Les précautions suggérées et un avis sur l'efficacité et la sécurité du RESC™ sont présentés dans cette Section.

Un **Guide d'Emploi Abrégé** du Conditionneur modèle AUTO-SANTÉ™ est fourni à la *Section-V*.

Les spécifications techniques et énergétiques sont résumées à la *Section-VI*.

À l'**Annexe-A**, l'importance de la classification non-médicale du RESC™ est soulignée avec plusieurs arguments convaincants. L'**Annexe-B** vous rappelle les trois "faux-problèmes" les plus fréquemment rapportés par les propriétaires du Conditionneur RESC™ et finalement, l'**Annexe-C** résume la garantie du manufacturier et ses conditions d'application.

Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie

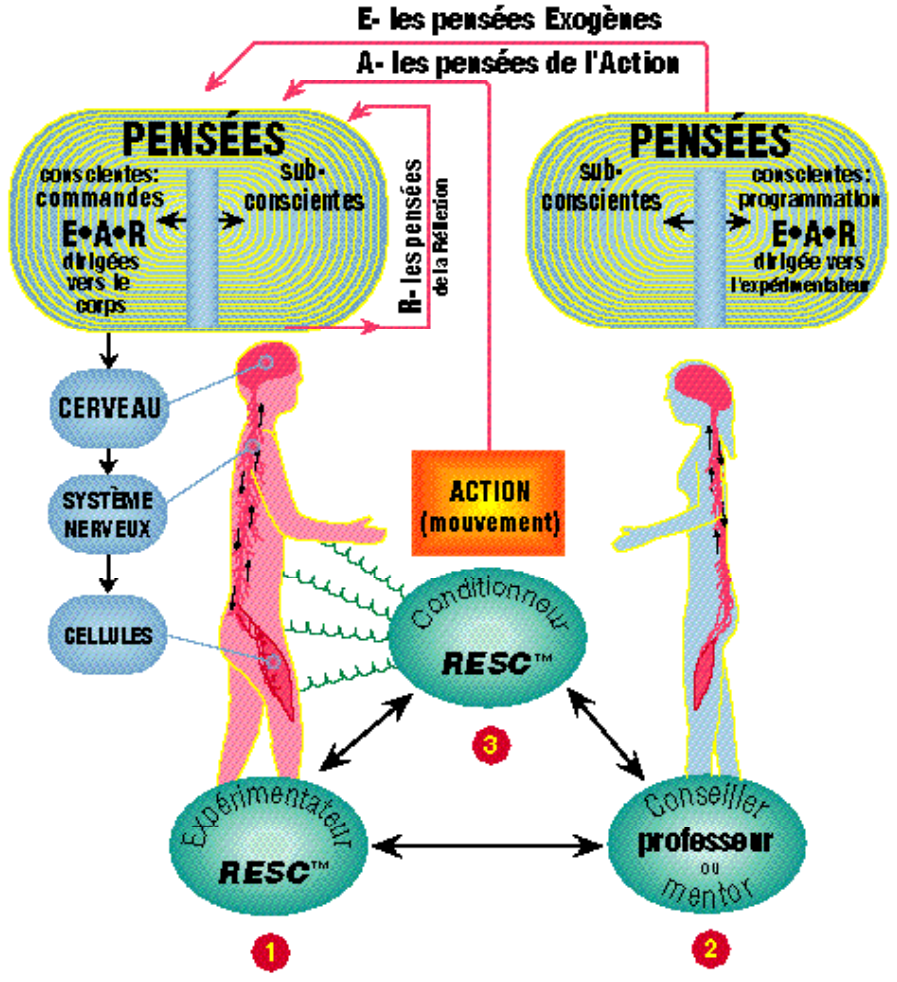

Le phénomène RESC™: son principe de fonctionnement

Avec la philosophie RESC™, l'expérimentateur améliore la perception mentale de son corps et redécouvre la Confiance en Soi, d'où découle la pensée positive qui l'aide à améliorer sa Santé et son Bien-être avec le Conditionneur RESC™

RESC™ est une **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE**™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE** sont des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, **L'institut RHUMART® international (iRi)**, Qc, Canada, janvier 1991.

Pour informations: **Montréal:** (514) 525-[redacted]

Section -I-

Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie -I-

Section -I-

Le RESC ™, Philosophie –

Le RESC™ Philosophie-Scientifique de la Vie™ -I-

qui utilise
la bioélectricité régénératrice RHUMART®

stimule
la **PENSÉE** positive
et vous conduit vers un meilleur
ÉTAT DE SANTÉ et
de bien-être intérieur

Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie est une approche holistique par laquelle tout être humain peut, à l'aide de la **méthode scientifique expérimentale**, découvrir les meilleurs paramètres de l'onde RHUMART® qui lui permettront d'améliorer sa santé et son bien-être en utilisant l'unique Conditionneur RESC™.

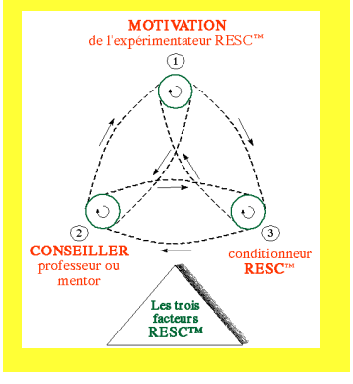

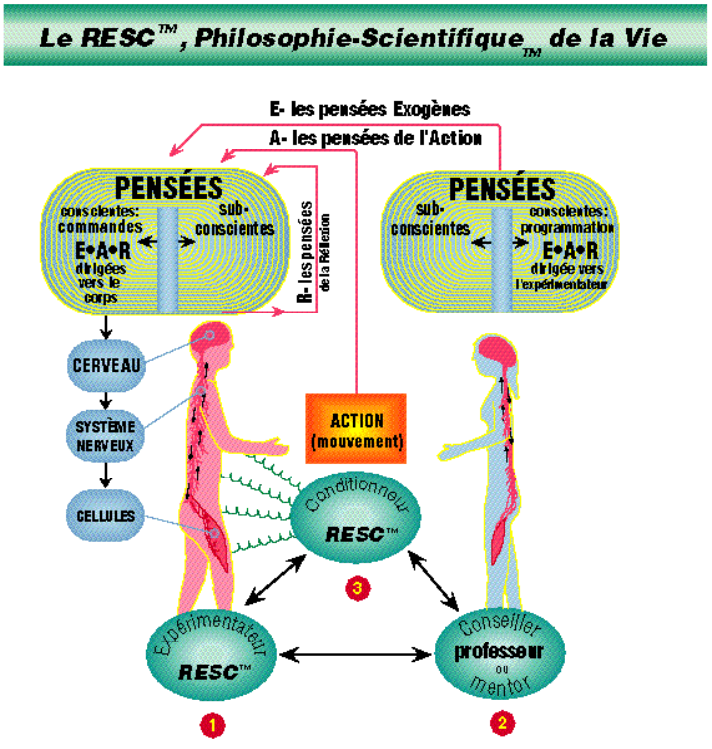

Le phénomène RESC™: Son principe de fonctionnement

Avec la philosophie RESC™, l'expérimentateur améliore la perception mentale de son corps et redécouvre la Confiance en Soi, d'où découle la pensée positive qui l'aide à améliorer sa Santé et son Bien-être avec le Conditionneur RESC™.

RESC™ est une **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE**™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE** sont des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, **L'institut RHUMART® international (iRi)**, Qc, Canada, janvier 1991.

Scientifique$_{TM}$ de la Vie -I-

Prenez un RESC™ !

Leconditionneur RESC™ } ------- *vous permettra d'améliorer* ----> { • **votre pensée** • **votre santé et** • **votre bien-être**



Le conditionneur RESC™

La philosophie **RESC™** utilise un conditionneur du même nom, un appareil électronique de pointe, qui génère des impulsions bioélectriques uniques et brevetées de type RHUMART®, secondé d'un conseiller/mentor qualifié qui guidera l'utilisateur dans sa découverte des paramètres RHUMART® adaptés à l'utilisateur. (Brevets canadiens: 1113156 et 1150361 et autres pays)

Réseau International de Distribution

Nous avons établi un réseau international de Distributeurs Indépendants qui font connaître le RESC™ à l'échelle mondiale. Avec l'aide de ce réseau, les individus aux prises avec de graves problèmes de santé peuvent faire l'acquisition d'un conditionneur RESC™ afin de devenir maîtres de leur santé.

Ainsi, chaque être humain sera plus autonome et heureux avec la **Philosophie RESC™**, puisque "**Contrôler sa Santé**" signifie "**Contrôler sa Vie**", pierre angulaire de la Liberté et du Bonheur.

Le **Dr Roland A. Drolet** est né à Québec, au Canada (1944). Après avoir obtenu son **B.Sc.A. en Génie physique** de l'Université Laval (1967), il a complété sa maîtrise (**M.A.Sc.) et son doctorat (Ph.D.) en Génie biomédical** à l'Université de Toronto (1971). Il fut **professeur de Recherche biomédicale et de Génie électrique** à l'Université Laval, (1971)

Dr Roland A. Drolet, Ph.D., l'inventeur

Il fut le Directeur Fondateur de la **Division de Génie biomédical** du Centre Hospitalier de l'Université Laval (le CHUL), 1971-1975. Il a dirigé le Laboratoire de Magnétisme chez Northern Telecom à Montréal en 1967.

Depuis 1975, il a inventé, développé et évalué l'unique Conditionneur RESC™ associé à la Philosophie-Scientifique$_{TM}$ de la Vie surnommée Le RESC™.

votre Distributeur Indépendant du

Conditionneur

RESC™

Nom: .....

Tél.: ( ) .....

RESC™
RESC™

Section -II-

Le RESC™,
Philosophie-Scientifique™
de la Vie -II-

Définition et fonctionnement
du Phénomène RESC™

RESC™ est une **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE**™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE** sont des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc.
et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, **L'institut RHUMART® international (iRi)**, Qc, Canada, janvier 1991.

Le

Philosophie-Scientifique ™
de la Vie -II-

Comment et pourquoi

le RESC ™

peut vous aider

à

PENSER positivement,

AMÉLIORER votre SANTÉ et

PARVENIR à un BONHEUR durable

INTRODUCTION

Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie -II-

Définition: Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie est une approche holistique par laquelle tout être humain peut découvrir, à l'aide de la **méthode scientifique expérimentale,** les paramètres de l'onde RHUMART® qui lui permettent d'améliorer sa santé et son bien-être en utilisant l'unique Conditionneur RESC™.

PREMIÈRE PARTIE

LES PENSÉES sont DES «ENTITÉS PHYSIQUES» qui CONTRÔLENT votre VIE

Les pensées sont de véritables entités physiques, des séries de signaux électromagnétiques qui agissent telle une programmation d'ordinateur pour votre **Cerveau,** lequel répond conformément à la " formulation " exacte de l'ordre (avec la signification des mots telle que préenregistrée dans le conscient ou le subconscient).

Vous désirez des preuves ? En voici quelques unes.

Mentionnons tout d'abord les expériences parapsychologiques effectuées par des chercheurs américains qui ont prouvé que les **PENSÉES sont des ENTITÉS PHYSIQUES, puisqu'ils ont pu les détecter à l'extérieur du corps** et les enregistrer sur un papier photographique à très haute sensibilité.

Dans un domaine beaucoup plus évident, considérons les phénomènes physiques reliés à l'hypnose. Nul ne doutera de la conclusion découlant des faits suivants. Par exemple, un sujet sous hypnose (sous l'influence de la suggestion) est convaincu qu'il mange l'orange la plus succulente qui soit, alors qu'en réalité, il est en train de manger un citron "**sûr**".

Dans cet exemple, les terminaisons nerveuses sensorielles du goût ne répondent pas adéquatement ou le cerveau ne reconnaît pas leurs signaux comme significatifs. En fait, les signaux envoyés aux terminaisons nerveuses ne sont pas éliminés, ils sont « **inhibés** » par **l'ordre (signal électromagnétique)** de l'hypnotiseur.

À la suite de cet exemple, nous pouvons conclure que les **pensées** sont des **entités physiques** aussi réelles que les signaux électromagnétiques des terminaisons nerveuses sensorielles du goût.

J'aime toujours avoir trois bonnes raisons avant d'être convaincu de quoi que ce soit!

Voici donc mon troisième exemple, relié aux **signes physiologiques visibles extérieurement et induits chez un sujet hypnotisé**.

Le sujet s'imagine sur une **plage par une journée ensoleillée** et **torride** lorsqu'en réalité il se trouve dans un environnement frais d'air climatisé. Lorsque j'ai assisté à cette démonstration d'Yvon Iva à Québec, il y a plusieurs années, j'ai été impressionné de voir au moins 25 sujets hypnotisés répondre immédiatement à cette **suggestion de chaleur torride** en enlevant leurs vestons, leurs chemises, **après quoi ils se mirent à transpirer**! Je pouvais apercevoir les gouttes de sueur ruisseler sur leurs visages. Dieu merci, l'hypnotiseur avait suggéré qu'ils gardent leurs sous-vêtements, peu importe la chaleur...

Si vous êtes vraiment curieux, un cours pratique de quatre jours en hypnose vous convaincra qu'au moins 70% des élèves ont les **capacités pour devenir de bons hypnotiseurs**, s'ils sont prêts à y mettre l'effort requis.

Cela vous paraît incroyable! ... Eh bien! je l'ai fait et vous pouvez y parvenir si vous le voulez vraiment.

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que:

LES PENSÉES sont des ENTITÉS PHYSIQUES

- Les pensées sont des **séries de signaux électromagnétiques.**
- Les pensées agissent comme des "**suggestions hypnotiques"** à l'intention de votre mental, lequel contrôle votre corps par l'intermédiaire de votre cerveau ou CPU (Central Processing Unit).
- Les pensées peuvent agir comme des **programmes de commande** de votre corps.

LES PENSÉES sont générées de trois façons différentes

- **Pensées-E:** sont générées de l'EXTÉRIEUR par d'autres personnes incluant les pensées générées par ce que vous lisez en général.
- **Pensées-A:** sont générées par vos propres ACTIONS. C'est ce qu'affirmait **Jean PIAGET** il y a cent ans lorsqu'il disait: **"La pensée est l'intériorisation des actions de l'homme** tout au cours de sa vie.**"**
- **Pensées-R:** sont générées par l'activité mentale nommée **RÉFLEXION.**

LES TROIS ÉTAPES d'APPRENTISSAGE lorsque vous recherchez une CERTITUDE

Lorsque vous rêvez d'une certitude concernant n'importe quel sujet, les trois sources d'information suivantes vous sont suggérées pour découvrir la vérité:

1. ***LA RÉFLEXION PERSONNELLE***
2. ***L'EXPÉRIENCE D'AUTRUI***
3. ***SES PROPRES EXPÉRIENCES OU ACTIONS***

Conclusion sur le rôle de la PENSÉE POSITIVE

Maintenant, vous **connaissez le pouvoir de la pensée sur la perception de votre environnement, incluant la perception de votre corps.** En effet, c'est votre ESPRIT qui perçoit les différents états de votre corps. Vous réalisez alors **l'importance de la pensée positive sur votre santé et votre bien-être**.

Pour un traité encore plus scientifique sur **L'INFLUENCE** des PENSÉES dans votre vie, veuillez vous référer au "**SCHÉMA DE L'HOMME**" du Dr Roland A. Drolet (*Section III*).

DEUXIÈME PARTIE

DE LA PENSÉE POSITIVE au RESC™, Philosophie-Scientifique$_{TM}$ de la Vie

La pensée positive a souvent réalisé des "miracles". Plusieurs personnes condamnées, les meilleurs outils de diagnostic les ayant trouvées atteintes d'un **CANCER MORTEL** par exemple, ont recouvré la santé rapidement ou même "miraculeusement" parce qu'elles ont tout simplement **refusé les pensées ou suggestions négatives à l'égard de leur Santé ou de leur VIE en général.**

Toutefois, seule une minorité d'individus sur cette planète peut spontanément adopter une telle ATTITUDE MENTALE POSITIVE qui lui permet d'arriver à contrôler et résoudre **les perturbations physiologiques les plus sérieuses**, voire "chroniques" ou mortelles.

Ainsi, je vous propose d'analyser vos problèmes de santé d'un nouvel oeil.

Vous devez d'abord réaliser que la **MALADIE en général n'est pas une entité physique.** Les désordres physiologiques ne sont que des perturbations des paramètres "normaux". L'absence de maladie "détectée" par la médecine officielle est bien plus la "**Santé Physique Apparente**" que la santé de l'être dans sa totalité psychosomatique.

L'approche globale de la Santé utilisée avec **la Philosophie RESC™** est beaucoup plus adéquate que cette définition physique simpliste. La Santé, c'est beaucoup plus que l'absence de **maladie** comme en témoignent les chapitres suivants.

(Se référer aux 7 lois de l'autosanté définies par le Dr Tom Ferguson et citées dans le Journal RHUMART®, Vol. 1, Nº 3, septembre l990; voir la référence Nº 8).

DÉFINITION DE LA SANTÉ en terme de PENSÉE POSITIVE

DÉFINITION DE LA SANTÉ
en terme de PENSÉE POSITIVE

LA SANTÉ est un ÉTAT D'ESPRIT dans lequel vous vous sentez bien, parce que **vous savez que vous avez le pouvoir de contrôler votre VIE** et vous êtes sûrs de réaliser tous vos objectifs personnels par:

- **Votre motivation**
- **L'aide des autres**, incluant les meilleurs professeurs
- **Les merveilleux "outils"** qui sont à votre portée

Vous réalisez que toute personne qui souffre de diverses "maladies" selon la définition traditionnelle de la SANTÉ, peut être en excellente santé lorsque celle-ci est définie **en termes de "Pensée Positive".** Quelle merveilleuse perspective!

LA MOTIVATION À ÊTRE EN SANTÉ

Toute amélioration ou résolution d'un problème de santé commence par la motivation individuelle à **guérir** ou à résoudre son problème. Si l'on ne s'arrête même pas pour chercher des solutions, on conservera une attitude négative qui mène à la dépression et risque d'aggraver son problème. Voilà pour le premier facteur RESC™, la **motivation à guérir.**

L'effet Placebo Positif

À propos de l'aide venant des autres, il nous faut considérer les "outils" utilisés ou recommandés par les conseillers en santé. **L'effet Placebo Positif** dépend de l'attitude de ce conseiller, de la façon dont il s'implique véritablement et se soucie sincèrement de l'évolution de son "protégé". Si ces conseillers/mentors ne favorisent que l'effet Placebo qui, à mon avis, n'est qu'un faible reflet de l'attitude mentale positive de l'individu "malade", cette approche n'en demeure pas moins supérieure à l'approche "médicale" traditionnelle qui favorise de façon irréfléchie l'ingestion de drogues chimiques pour aider à résoudre tout problème de santé, même chronique. Je ne dis pas que ces médicaments ne sont pas pratiques ou recommandables dans les cas de **crises aiguës** d'arthrite ou de **problèmes inflammatoires** par exemple, mais l'absorption de ces produits chimiques peut causer de nombreux effets indésirables, voire néfastes.

Habituellement les établissements médicaux parlent de l'effet Placebo mais ne mentionnent jamais s'il s'agit d'effets positifs ou négatifs. Pourquoi ? Ceci fait partie d'un SECRET bien "établi" qui nous a été révélé lors d'une étude menée par des gradués du "Harvard Business School" des Etats-Unis (Cambridge).

Que nous a révélé cette étude? **Que 70% des résultats obtenus par les médecins sont reliés à l'effet Placebo** (lequel je qualifie d'effet Placebo Positif).

L'effet Placebo Négatif

L'auteur qualifie **d'effet placebo négatif l'effet produit par un clinicien à l'attitude négative qui déprécie ou se montre indifférent au moyen de "traitement" sous évaluation.**

L'attitude négative du chercheur peut parfois anéantir complètement la **motivation à guérir du** "malade". En de telles circonstances, les résultats peuvent être nuls ou négatifs, même avec une bonne technique thérapeutique, et ceci est **uniquement causé par la puissante influence de pensées négatives sur la personne "malade"** (n'oublions pas la **situation précaire** de l'individu par rapport au chercheur).

De MERVEILLEUX "outils" mis à votre disposition

Je ne m'arrêterai pas à détailler tous les "outils" ou "systèmes" mis à votre disposition et vous permettant de recouvrer la santé et l'harmonie. Je me limiterai à ce que je connais le mieux: le **Conditionneur RESC™** qui utilise des impulsions bioélectriques de type RHUMART®, très similaires à celles du système nerveux humain.

Pour quelles raisons cet "outil" spécifique serait-il meilleur que tout autre moyen thérapeutique antérieur?

Premièrement, parce que le **Conditionneur RESC™, lorsqu'utilisé correctement, peut vous aider de différentes façons** encore jamais disponibles avec les moyens antérieurs.

En effet, **le conditionneur RESC™ peut vous aider à améliorer et maintenir votre santé en renforçant vos mécanismes d'auto-défense et de guérison** par l'induction des effets physiologiques suivants:

1. **L'amélioration de la circulation sanguine;**
2. **La relaxation du système nerveux,** produisant des effets anti-inflammatoires et anti-douleur;
3. **La stimulation de la réparation et de la régénération cellulaire.**

Initialement, l'utilisateur du Conditionneur RESC™ a besoin d'un conseiller expérimenté ou "mentor" pour l'aider à découvrir les paramètres de l'onde RHUMART® qui lui sont le mieux adaptés. Le conditionnement RESC™ l'aidera à avoir une meilleure perception de son corps **(spécialement lorsqu'il a réussi à contrôler ses douleurs et qu'il a recouvré le sommeil).**

Avec la perception mentale d'un **corps bien détendu et sans douleur**, l'utilisateur redécouvrira la confiance en soi, avec l'aide du **RESC™**. Son **Attitude Positive** l'aidera à contrôler sa santé et sa joie de vivre par des **Cycles d'Actions Positives**, incluant le Conditionnement RESC™, dont les paramètres seront choisis par l'utilisateur lui-même.

Le concept de **Cycles d'Actions Positives** peut être "visualisé" à l'aide du **Schéma de l'Homme** dans lequel est illustrée l'influence décisive des Pensées générées par l'Action, lesquelles agissent sur les **Centres de Perception du Cerveau.**

L'état de détente de l'usager aidera à l'amélioration de sa **circulation sanguine**, **à la réparation et la régénération cellulaire. Les (3) effets physiologiques de base du Conditionnement RESC™ peuvent maintenant être considérés comme des effets directs des Pensées générées par l'Action** aussi bien que des effets produits **indirectement par les impulsions bioélectriques uniques et brevetées de l'ordre de 20µA/cm²** du type et d'intensité des impulsions de courant d'ions calcium (Ca^{++}) essentielles à la transmission synaptique et nécessaires à **l'entretien, à la réparation et au contrôle de tous les processus de vie connus.**

Le rôle joué par les impulsions de courant d'ions calcium a été démontré par L. Llïnas dans le Scientific American Journal, October l982, L. Llïnas, Calcium in Synaptic Transmission of Nerve Signals.

Conclusion sur la Philosophie RESC™ et le BONHEUR

Nous avons vu comment le Conditionneur RESC™ peut vous aider à **Penser Positivement** en améliorant "rapidement" la perception de votre corps comme étant détendu et en santé. En d'autres termes, vous vous sentez plus "jeunes" et confiants de la qualité de votre corps que vous ne percevez plus comme un misérable habitacle de votre âme!

L'amélioration de votre état de Santé résulte indirectement des effets physiologiques du conditionnement RESC™.

Et au sujet du BONHEUR? Comment le RESC™ peut-il vous aider à acquérir le bonheur durable? Eh bien, c'est l'objectif le plus précieux convoité par tous les humains.

Le BONHEUR, tout comme la SANTÉ, est **un État d'Esprit** ou plus exactement, cela est étroitement lié à votre niveau de **CONSCIENCE**.

Je me réfère aux 7 niveaux de conscience définis par KEN KEYES Jr dans le Best Seller américain intitulé: "**Manuel pour une Conscience Supérieure**"; les niveaux de conscience suivants y sont définis.

Les 7 niveaux de conscience selon Ken KEYES Jr

Les 3 niveaux de souffrance et d'insatisfaction

1. Le centre de **sécurité**
2. Le centre des **sensations**
3. Le centre du **pouvoir**

Les 4 niveaux de joie et de bonheur

4. Le centre de **l'amour**
5. Le centre de **l'abondance**
6. Le centre de la **conscience de soi** (vu de l'extérieur)
7. Le centre de la **conscience cosmique**

Chaque être humain agit selon un de ces 7 centres de conscience.

Je puis vous assurer que le bonheur durable **repose** sur les **quatre** niveaux **supérieurs** de conscience définis par KEN KEYES Jr. Les trois premiers niveaux sont les **centres** de conscience reliés à la souffrance et à l'insatisfaction.

Afin d'être vraiment heureux, chacun doit **"penser positivement"** et agir (la plupart du temps) selon l'un des **quatre** niveaux **supérieurs de conscience: l'AMOUR, l'ABONDANCE, la CONSCIENCE DE SOI et la CONSCIENCE COSMIQUE.**

Finalement, comment le **Conditionnement RESC™** peut-il vous aider à **acquérir un bonheur durable et à vivre dans les niveaux de conscience supérieure?**

Il est évident que le Conditionnement RESC™, en vous aidant à restaurer votre santé, **réduira la durée de vos moments d'insécurité.**

Il vous **aidera également à élever votre esprit au-dessus du niveau des sensations** parce que vous éprouverez un bien-être que vous n'auriez pu ressentir avec vos problèmes antérieurs de santé.

Parce que vous découvrirez **la véritable signification de la santé et du bonheur dans des niveaux de conscience supérieure,** vous ne vous attarderez plus autant dans le niveau de conscience du POUVOIR.

De plus, les bienfaits que vous ressentirez avec le Conditionnement RESC™ vous conduiront naturellement vers les niveaux de **BIEN-ÊTRE d'une conscience supérieure.**

Ainsi, de chacun de ces niveaux de conscience supérieure, vous verrez désormais votre vie et celle des autres avec des yeux "polarisés positivement"**.** Puis, vous découvrirez **le Bonheur d'aider les autres à acquérir la SANTÉ et le BONHEUR DURABLE.**

Vos pensées et vos actions seront dorénavant motivées, la plupart du temps, par l'AMOUR, l'ABONDANCE, LA CONSCIENCE DE SOI et la CONSCIENCE COSMIQUE... Alors seulement, vous connaîtrez l'expérience d'un bonheur durable.

RÉFÉRENCES

1. Drolet, R.A., 1990, **Le RESC™, Philosophie-Scientifique$_{TM}$ de la Vie-I**, L'institut RHUMART® international (iRi), (C.P. 9968, Ste-Foy, Québec, Canada, G1V 4C5) (voir *Section-I* du présent GUIDE D'EMPLOI).

2. Drolet, R.A., 1990, **Devenez maitre de votre santé avec le Système AUTO-SANTÉ RHUMART®** ou **L'étincelle-de-Vie™ RHUMART®**, **Journal RHUMART®**, Médecine-Bioélectrique Inc., (C.P. 9968, Ste-Foy, Québec, Canada), pp. 18-19, Vol.1, No1, mars 1990.

3. Drolet, R.A., 1990, **Le Schéma de l'Homme**: Origine, survie, évolution, développement et Santé de l'Homme, **Journal RHUMART®**, Médecine-Bioélectrique Inc., (C.P. 9968, Ste-Foy, Québec, Canada, G1V 4C5), pp. 62-68, Vol.1, No 1, mars 1990.

4. Drolet, R.A., 1990, **L'Anti-Stress-RHUMART®**, **Journal RHUMART®**, Médecine-Bioélectrique Inc., (C.P. 9968, Ste-Foy, Québec, Canada, G1V 4C5), pp. 69-80, Vol.1, No 1, mars 1990.

5. Drolet, R.A.,1990, **La Physiologie RHUMART®**, **Journal RHUMART®**, Médecine-Bioélectrique Inc., (C.P. 9968, Ste-Foy, Québec, Canada, G1V 4C5), pp. 81-88, Vol.1, No 1, mars 1990.

6. Keyes, Ken Jr, 1975, **Manuel pour une conscience supérieure**, (première édition française, 1987), Les Éditions Universelles du Verseau, (C.P. 1074, Knowlton, Québec, J0E 1V0, Canada).

7. Hayward, S, 1989, **A Guide for the Advanced Soul,** In-Tune Books, (P.O. Box 1093, Crows Nest, NSW 2065, Australia.).

8. Ferguson, T., 1990, **Les 7 Lois de l'autosanté, Journal RHUMART®**, Médecine-Bioélectrique Inc., (C.P. 9968, Ste-Foy, Québec, Canada, G1V 4C5), p. 144, Vol.1, No 3, sept. 1990.

Section -III-

LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE EXPÉRIMENTALE appliquée au RESC™ et le SCHÉMA DE L'HOMME

> *L'ignorance même totale et profonde, en quelque matière que ce soit, n'est ni si dangereuse ni si grandement funeste; bien plus dommageable au contraire est d'avoir beaucoup appris et de beaucoup savoir* ***sans une méthode****"*
> *(**Platon**, Les Lois, VII, 819a)*

La Méthode Scientifique Expérimentale

Nous référant aux *Sections I et II* ci-dessus, de même qu'au Schéma de l'Homme du Dr Roland A. Drolet, Ph.D., nous constatons que la Philosophie RESC™ enseigne la **Méthode Scientifique Expérimentale** à toute personne qui veut améliorer sa pensée positive, sa santé et son bien-être en utilisant l'unique Conditionneur RESC™ dont la technologie est brevetée.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la méthode scientifique expérimentale, veuillez considérer le simple schéma suivant qui illustre très bien cette méthode:

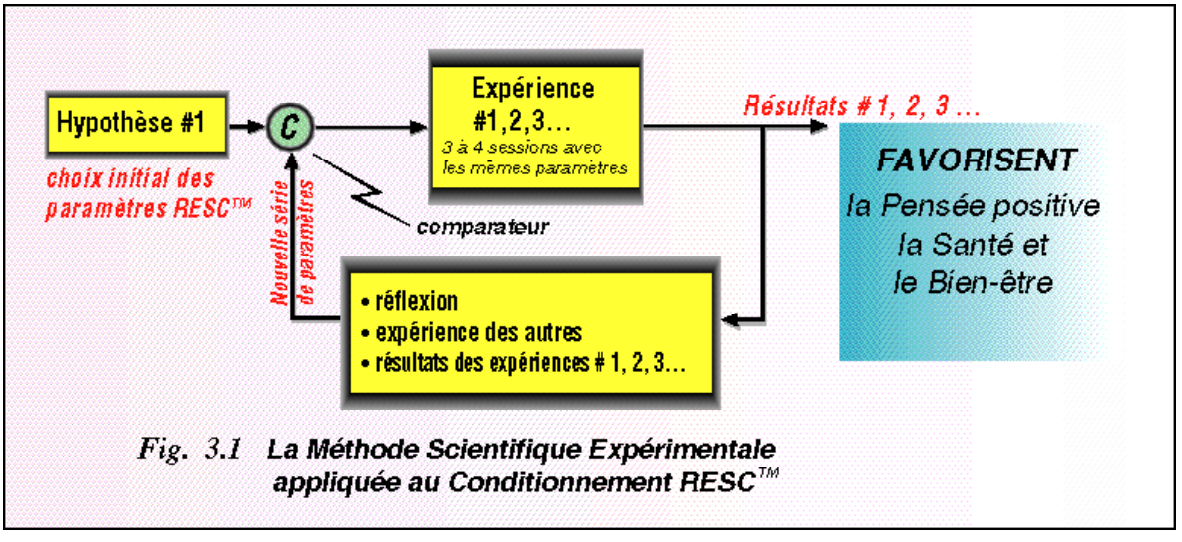

Fig. 3.1 ***La Méthode Scientifique Expérimentale appliquée au Conditionnement RESC™***

La Méthode Scientifique Expérimentale (suite)

Le nouveau propriétaire du Conditionneur RESC™ doit recevoir la formation appropriée de son **mentor**, parrain ou professeur qui a lui-même expérimenté la technique RESC™.

Ayant reçu l'entraînement adéquat, l'expérimentateur du RESC™ choisit les paramètres initiaux du Conditionnement (Hypothèse #1, Fig.3.1): l'Amplitude (A), la Modulation (n), la Durée de la session (T) et les applicateurs de son choix, selon les instructions du présent GUIDE et en particulier celles des *Sections-IV et V*.

L'expérimentateur RESC™ compare son état de santé (ou d'esprit) avant et environ une journée après l'utilisation de son Conditionneur Auto-Santé™.

Selon la perception qu'il a de son corps environ 24 heures après sa première session de Conditionnement, il continue avec les mêmes paramètres pour 3 à 4 sessions ou il modifie les paramètres pour la deuxième session.

À moins qu'il se sente vraiment mal, l'utilisateur devrait utiliser les mêmes paramètres pour au moins 3 à 4 sessions consécutives.

Chaque session RESC™ est une expérience scientifique où l'utilisateur est l'expérimentateur ou le chercheur. Son mentor peut le guider lorsqu'il a besoin d'aide ou de formation supplémentaire pour utiliser son conditionneur adéquatement.

Après chaque session (ou le lendemain), l'utilisateur-expérimentateur se sert de sa capacité de réflexion et de l'expérience des "connaisseurs" du RESC™ pour juger d'un nouveau choix de paramètres de Conditionnement (hypothèses #2,3,4,...)

Après un certain nombre de sessions variant d'un individu à l'autre, l'utilisateur améliore son état de santé et de bien-être général, atteignant un mode de pensée de plus en plus positif et scientifique.

Le Schéma de l'Homme

organisation et contrôle de l'homme

Dr Roland A. Drolet, Ph.D.

- **NOTE 1:** **LA CONSTRUCTION DU SAVOIR** est orientée dans le sens d'une conceptualisation toujours plus abstraite et plus générale. (Jean Piaget)

  Aussi l'homme ne peut comprendre un nouveau concept que s'il en a déjà tous les éléments à l'intérieur de lui-même. Il est impossible de prédire le comportement global d'un système à partir de la seule connaissance de ses éléments constituants, et rien n'est compréhensible si ce n'est que par son histoire.

- **NOTE 2:** **LA NATURE DE LA PENSÉE:** Le fondement de la connaissance repose sur une conception qui fait de l'ACTION une phase précédant la pensée et de la pensée elle-même un processus d'intériorisation des actions de l'homme au cours de sa vie. (Jean Piaget)

  Les pensées sont des entités physiques car elles peuvent être détectées hors du corps.
  ("THOUGHTS ARE THINGS", selon A. Tanous, parapsychologue américain de renommée.)

- **NOTE 3:** **LES EXEMPLES DE CONTRÔLE PSYCHOLOGIQUE:**

  1. Biofeedback
  2. Hypnose
  3. Sommeil
  4. GSR
  5. Vasodilatation
  6. Débit sanguin
  7. Fréquence cardiaque
  8. Pression artérielle
  9. Fréquence respiratoire
  10. Température du corps
  11. Activité de l'hypothalamus et de l'hypophyse
  12. Hormones
  13. Division cellulaire
  14. Croissance
  15. Reproduction
  16. Homéostasie

- **NOTE 4:** **LES ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE DE LA SURVIE DE L'HOMME: SUR (1 à 7)**
  1. Le code génétique terrestre
  2. La nutrition appropriée à l'espèce (incluant les médicaments)
  3. La bioélectricité régénératrice (ex.: la technique RHUMART®)
  4. La gravité terrestre (effets mécaniques et piézoélectriques)
  5. Les pensées conscientes et subconscientes (Notes 2, 3, 9 et 10)
  6. Les dix sens (Note 7)
  7. Diverses radiations électromagnétiques (Notes 8 et 12)

- **NOTE 5:** **IL EXISTE TROIS MOYENS FONDAMENTAUX D'APPRENDRE:**
  1. La réflexion
  2. L'expérience des autres } $\sum_{1,2,3}$= CONVICTION ou CERTITUDE
  3. Sa propre expérience

© Droits d'auteur, DR Roland A. DROLET, QUÉBEC, JANVIER 1984

- **NOTE 6:** **PENSER ou AGIR:** A force de penser sans agir, l'esprit humain (et le cerveau) s'atrophie et finit par être dominé par les pensées et perturbations externes.

- **NOTE 7:** **LES DIX SENS: SE (1 à 10)**

1. La vue
2. L'ouïe
3. L'odorat
4. Le goûter
5. Le toucher
6. La faim
7. La soif
8. Le plaisir (ex.: sexe)
9. La peur (ex.: stress)
10. La douleur (physique, psychologique)

- **NOTE 8:** **LES RADIATIONS ATMOSPHÉRIQUES: RA (1 à 4)**

1. Les radiations très énergiques (rayons γ, rayons X, etc...)
2. Les radiations ultraviolettes, visibles et infrarouges
3. Les radiations non-ionisantes (micro-ondes, ondes courtes, VHF,UHF,HF,RF)
4. Les orages électriques et magnétiques, résonances de Schumann (1952)

- **NOTE 9:** **LES INFLUENCES EXTÉRIEURES SUR L'ESPRIT SUBCONSCIENT: PS (1 à 6)**

1. Les pensées injectées subliminalement
2. Les pensées imposées durant un état d'hypnose
3. Les pensées stimulées par la méthode DIANÉTIQUE
4. Les pensées étrangères (esprits actifs)
5. Les pensées stimulées par l'esprit conscient
6. Les pensées générées par l'ACTION

- **NOTE 10:** **LES INFLUENCES EXTÉRIEURES SUR L'ESPRIT CONSCIENT: PC (1 à 4)**

1. Les pensées étrangères
2. Les pensées stimulées par la méthode **DIANÉTIQUE**
3. Les pensées stimulées par l'esprit subconscient
4. Les pensées générées par l'**ACTION**

- **NOTE 11:** **ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU CORPS: EN (1 à 5)**

1. Oxygène, O_2, atomes, molécules,
2. Animaux, végétaux, médicaments
3. Champs électriques et magnétiques, gravité
4. Radiations artificielles (note 12)
5. Ions - et +

- **NOTE 12:** **RADIATIONS ARTIFICIELLES: RAA (1 à 12)**

1. E L F
2. L' onde-RHUMART®
3. Radio, RF
4. TV
5. H F
6. U H F
7. Micro-ondes
8. Infrarouge
9. Visible
10. U V
11. Rayons-X
12. Rayons γ

© Droits d'auteur, Dr Roland A. DROLET, QUÉBEC, JANVIER 1984

Le SCHÉMA de l'HOMME du
Dr Roland A. DROLET, Ph. D
Pensée
Temps
Action

Le Schéma de l'Homme et
la Méthode Scientifique Expérimentale

Le Schéma de l'Homme présenté à la Fig. 3.2 résume de façon schématique l'organisation générale et le fonctionnement de l'être humain.

Ce schéma est basé sur les connaissances historiques, philosophiques et scientifiques de l'Homme, sur son origine, sa survie, son évolution, son développement et sa santé, connaissances acquises depuis plus de 2000 ans.

Seulement ce qui est connu avec certitude (et prouvé à l'esprit des vrais scientifiques) a été incorporé à ce schéma. L'auteur fait ressortir **l'interrelation** entre plusieurs "éléments" ou composantes de l'Homme, ce qui permet de mieux en comprendre le fonctionnement global par l'approche holistique RESC™.

La discussion sur l'origine, la survie et l'évolution (du type Darwin) de l'Homme sort de la portée du présent GUIDE D'EMPLOI et sera présentée par l'auteur dans un volume spécial consacré à l'organisation générale et au contrôle de l'Homme vu dans sa totalité.

Ici et maintenant, l'auteur est principalement concerné par le **Développement et la Santé** de l'Homme tels que reliés au **Conditionnement et à la Philosophie RESC™**.

Nous avons vu précédemment comment **la Méthode Scientifique Expérimentale** s'applique magnifiquement au conditionnement RESC™. Ici, nous voulons vous aider à visualiser une expérience scientifique, telle une session de conditionnement RESC™, en utilisant le Schéma simplifié de l'Homme de la Fig. 3.2.

Toute expérience scientifique, incluant une session de conditionnement RESC™, peut être vue comme un **Cycle-d'Action-Positive** à partir du Schéma de l'Homme.

Nous pouvons visualiser le choix initial des paramètres RESC™ (et les choix subséquents) comme un événement psychosomatique impliquant le corps et l'esprit de l'Homme, représentés par deux gros octogones dans ledit Schéma de l'Homme (Fig.3.2).

Le Schéma de l'Homme... (suite)

En effet, **le choix des paramètres** de l'onde RHUMART® comporte les étapes successives de l'apprentissage par la réflexion personnelle, par l'expérience des autres et finalement par les conclusions tirées d'expériences personnelles antérieures, telles les sessions de Conditionnement RESC™ décrites à la présente Section (Fig. 3.1).

Ceci est la première étape de l'expérience scientifique, soit la **réflexion et l'analyse** des résultats et expériences antérieurs.

La seconde étape importante de l'expérimentation scientifique du Conditionnement RESC™ est **l'adaptation des paramètres** de conditionnement selon la façon dont on perçoit son corps après une ou plusieurs sessions de conditionnement.

Cette étape implique **les Pensées-générées-par-l'Action** agissant sur les centres supérieurs de perception du cerveau, via un ou plusieurs des 10 sens illustrés dans ledit Schéma. Ce concept a été discuté par le même auteur dans le Journal RHUMART®, Vol.1, No 1 et Vol.1, No 2 dans la Section intitulée "Du doute à la Vérité RHUMART®" (voir la citation sur la Philosophie de Yung, celle permettant de vérifier si une vérité est une vraie vérité).

Ainsi, quand l'expérimentateur a choisi une nouvelle série de paramètres, **il doit ingérer ces données et voir si elles sont compatibles avec toute l'information qu'il possède déjà**. Il doit vérifier comment il se sent en vivant avec cet ensemble de paramètres. S'il se sent bien et ne ressent aucun signe physique désapprobateur (ex.: maux de tête, d'estomac ou autre), il devrait utiliser cette série de paramètres dans sa prochaine session ou expérience RESC™. **Après quelques mois d'expérimentation, la méthode de conditionnement RESC™ aide l'individu à améliorer la perception mentale de son corps.**

Avec la perception mentale d'un corps relaxé et libéré de toute douleur, l'utilisateur du RESC™ redécouvre la **Confiance en Soi** d'où découle la pensée positive. **Ceci l'aidera à contrôler sa santé et son bien-être au moyen de "Cycles-d'Actions-Positives" incluant des sessions de Conditionnement RESC™.**

Section -IV-

Les Conditionneurs RESC™ et leur utilisation

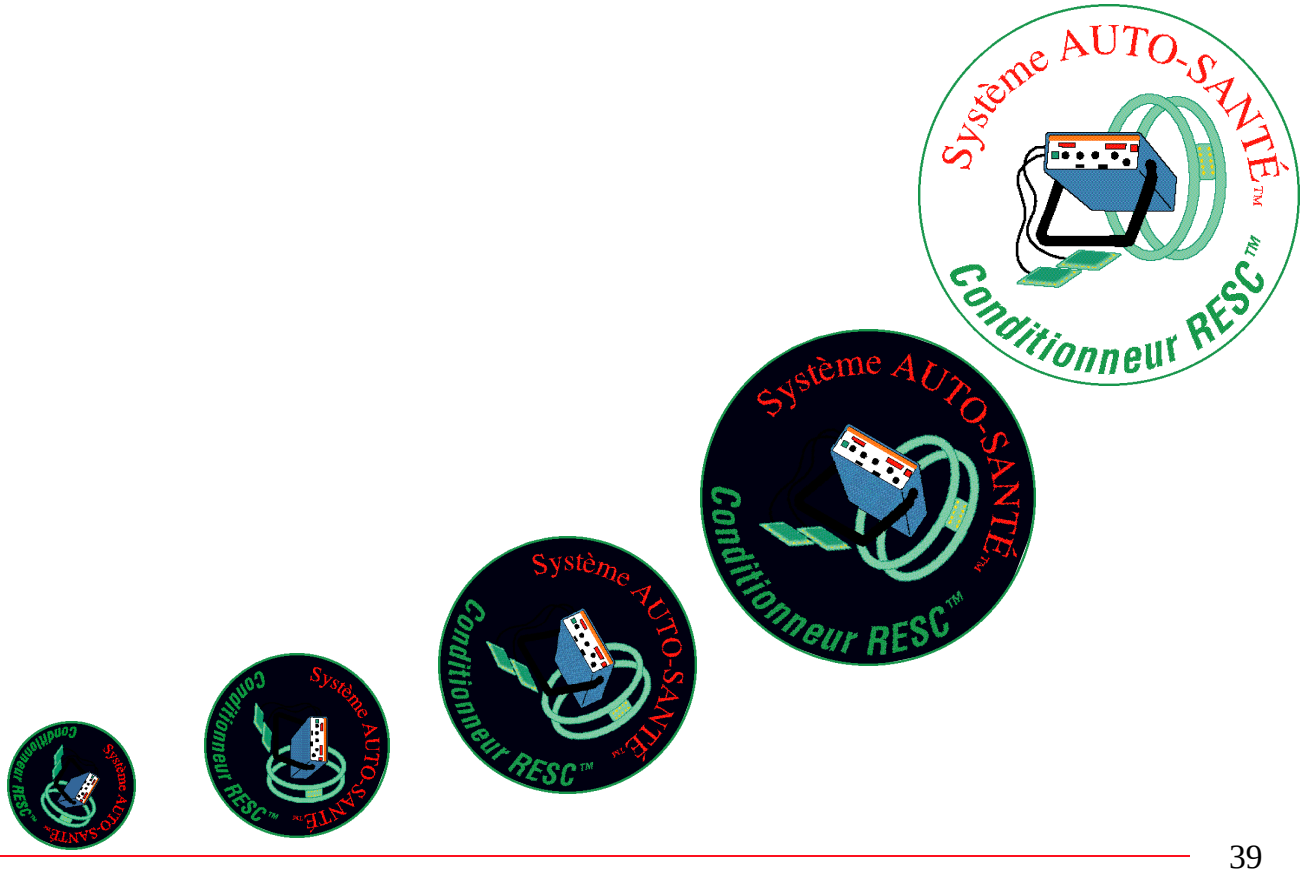

Le conditionneur RESC™ Modèle AUTO-SANTÉ™ De Luxe

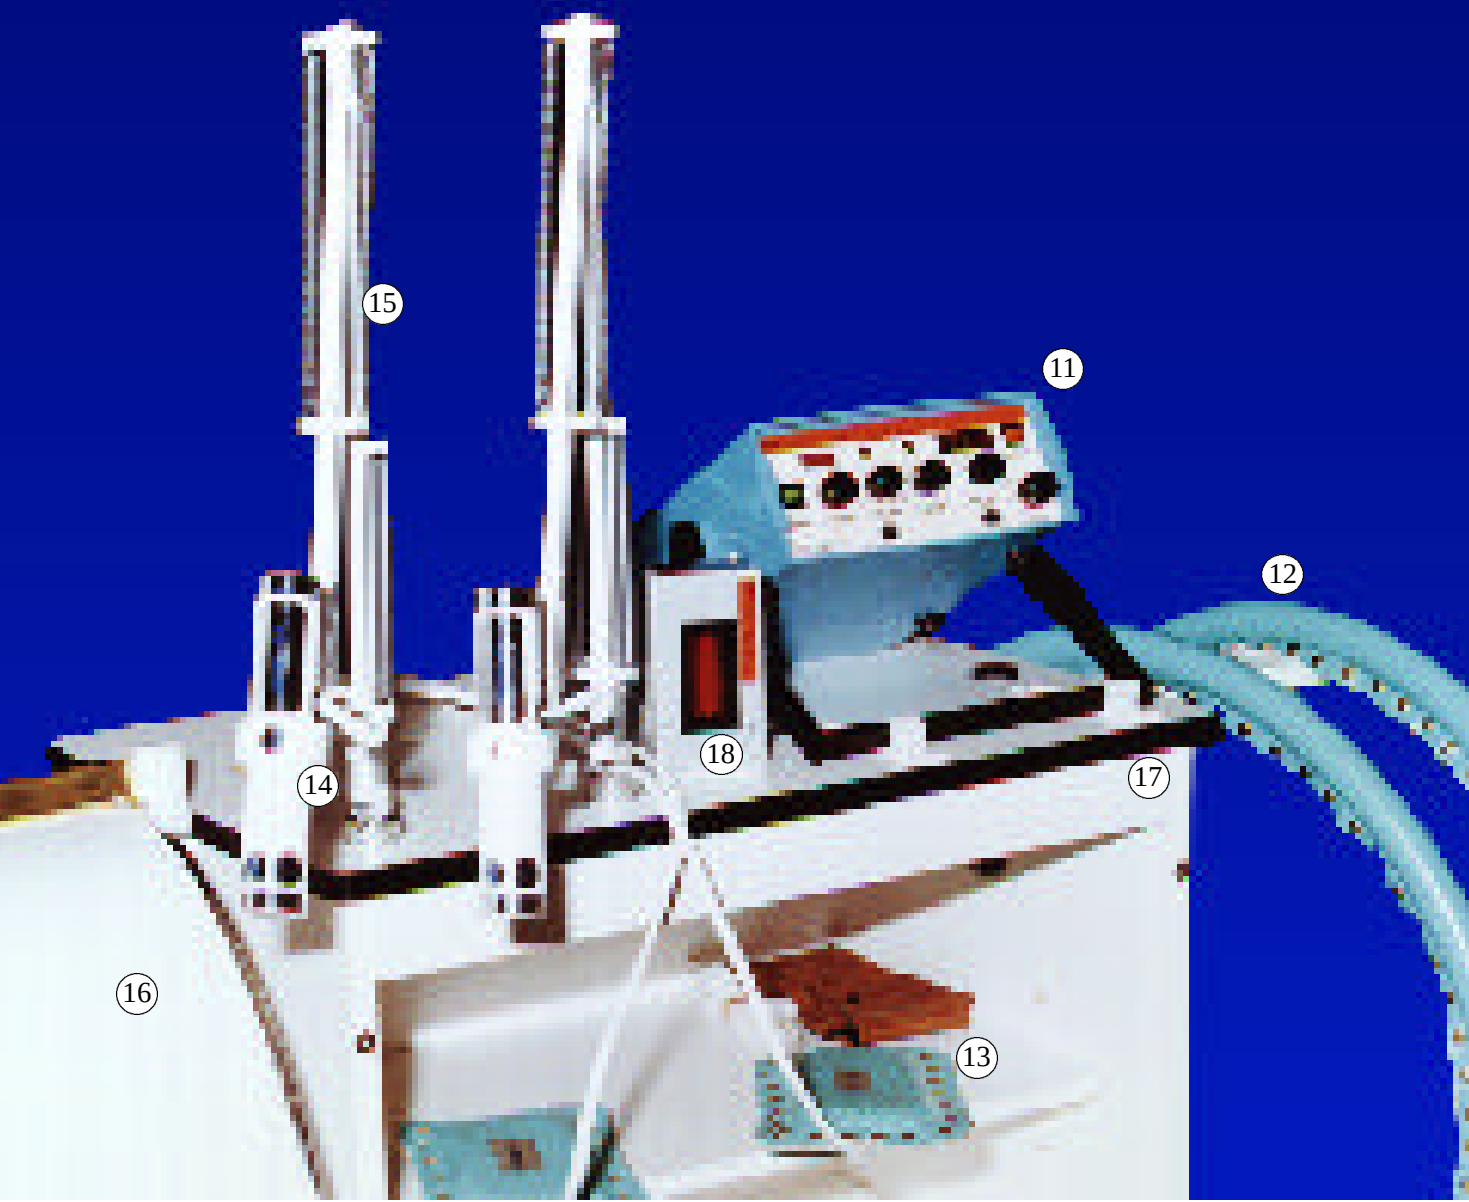

Section-IV: Les Conditionneurs RESC™ et leur utilisation

Composantes des deux modèles du Conditionneur RESC™

(A) **Le Conditionneur RESC™, Modèle Auto-Santé™** comprend:

(voir la Fig. 4.2 pour identifier les composantes)

- le Contrôleur RESC™, MBI-3000, (11)
- paire d'anneaux géants MAXI-2A, (12)
- paire d'applicateurs régionaux REBONE-4A, (13)
- valise et accessoires du MBI-3000
- ensemble d'extensions de 12'
- guide d'emploi du Conditionneur RESC™

(B) **Le Conditionneur RESC™, Modèle Auto-Santé™ De Luxe** comprend:

(voir la Fig. 4.1 pour identification des composantes)

- le Contrôleur RESC™ MBI-3000, (11)
- paire d'anneaux géants MAXI-2A, (12)
- paire d'applicateurs régionaux REBONE-4A, (13)
- paire d'applicateurs locaux MINI-4A, (14)
- paire de bras flexibles BF-2 ,(15)
- applicateur global MAXI, (16)
- table RHUMART® (17)
- valise et accessoires du MBI-3000
- ensemble d'extensions de 12'
- GUIDE D'EMPLOI du Conditionneur RESC™

Ces deux systèmes de conditionnements RESC™ sont bien illustrés aux Figures 4.1 à 4.4

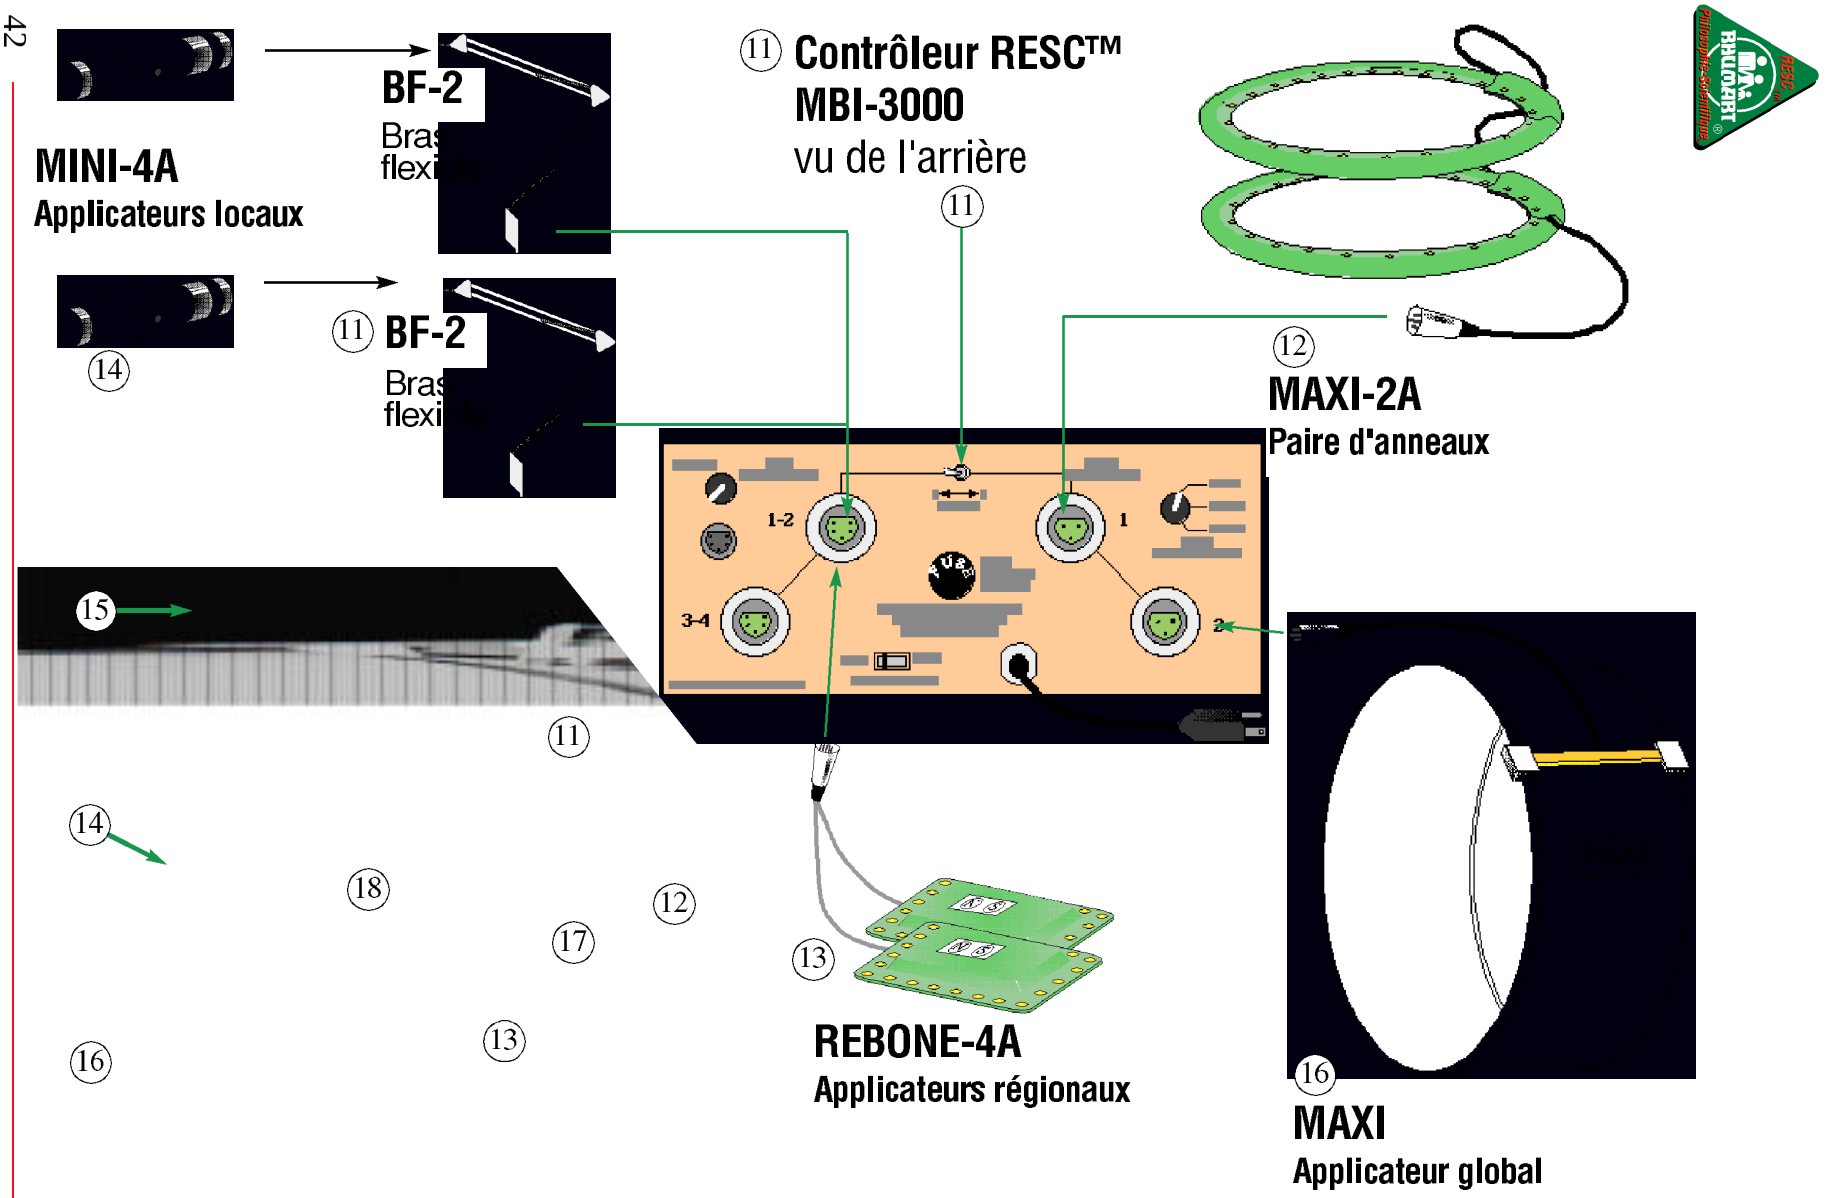

Fig. 4.1 Le Conditionneur RESC™ , Modèle Auto-Santé™ De Luxe

⑫ **MAXI-2A**
Paire d'anneaux

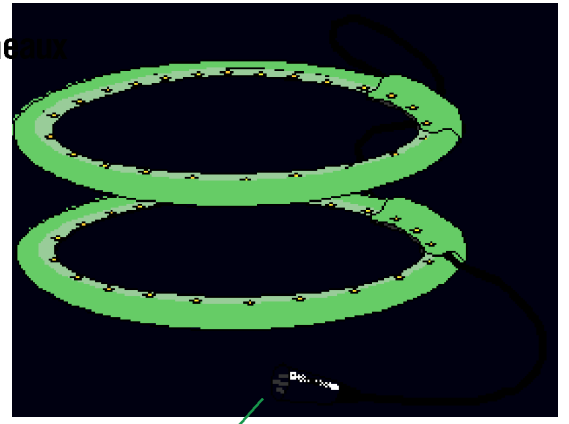

⑪
Contrôleur RESC™
MBI-3000
vu de l'arrière

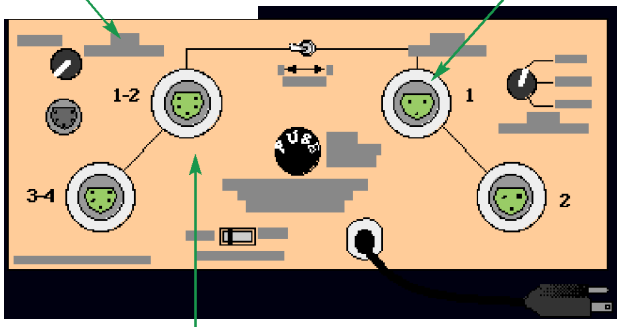

17

12

13

⑬ **REBONE-4A**
Applicateurs régionaux

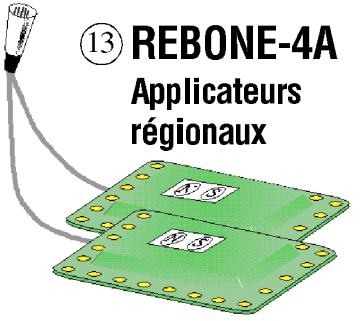

Fig. 4.2 Le Conditionneur RESC™, Modèle Auto-Santé™

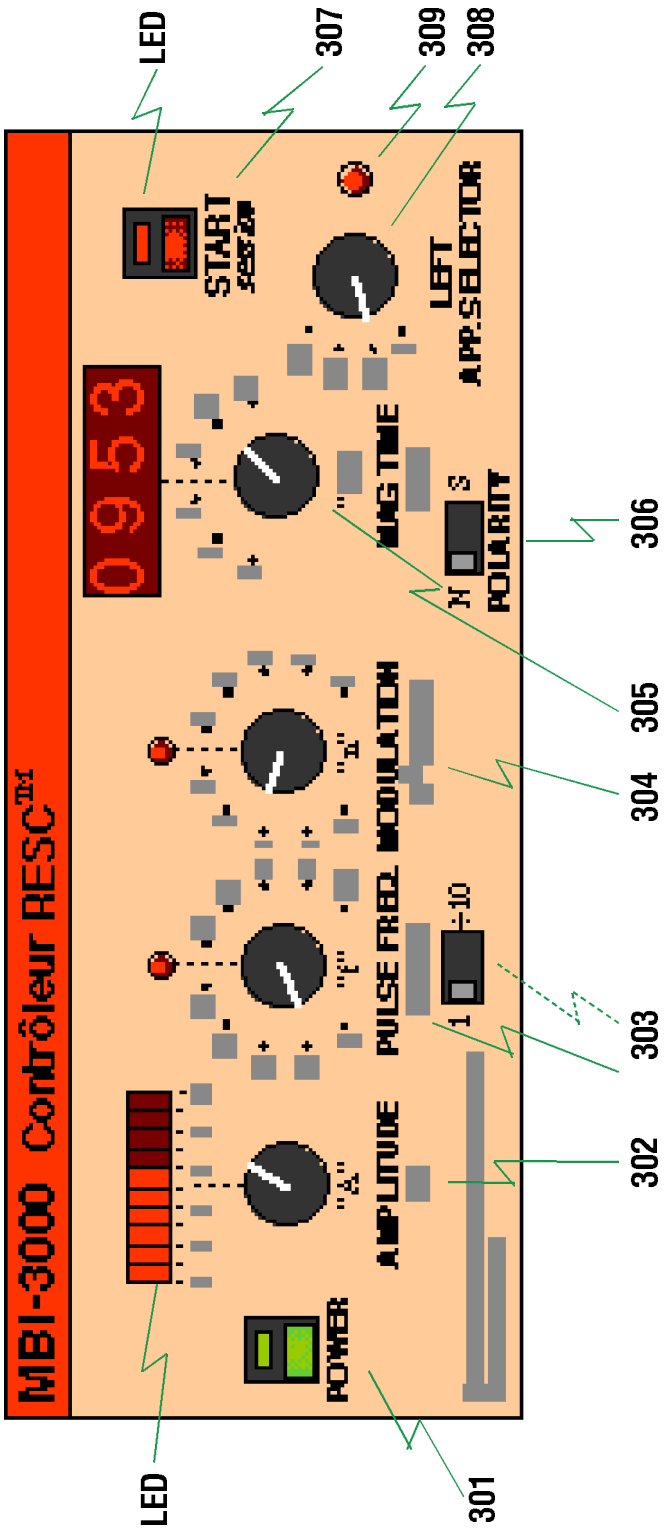

Fig. 4.3 Le Contrôleur RESC™ MBI-3000 *(Panneau avant)*

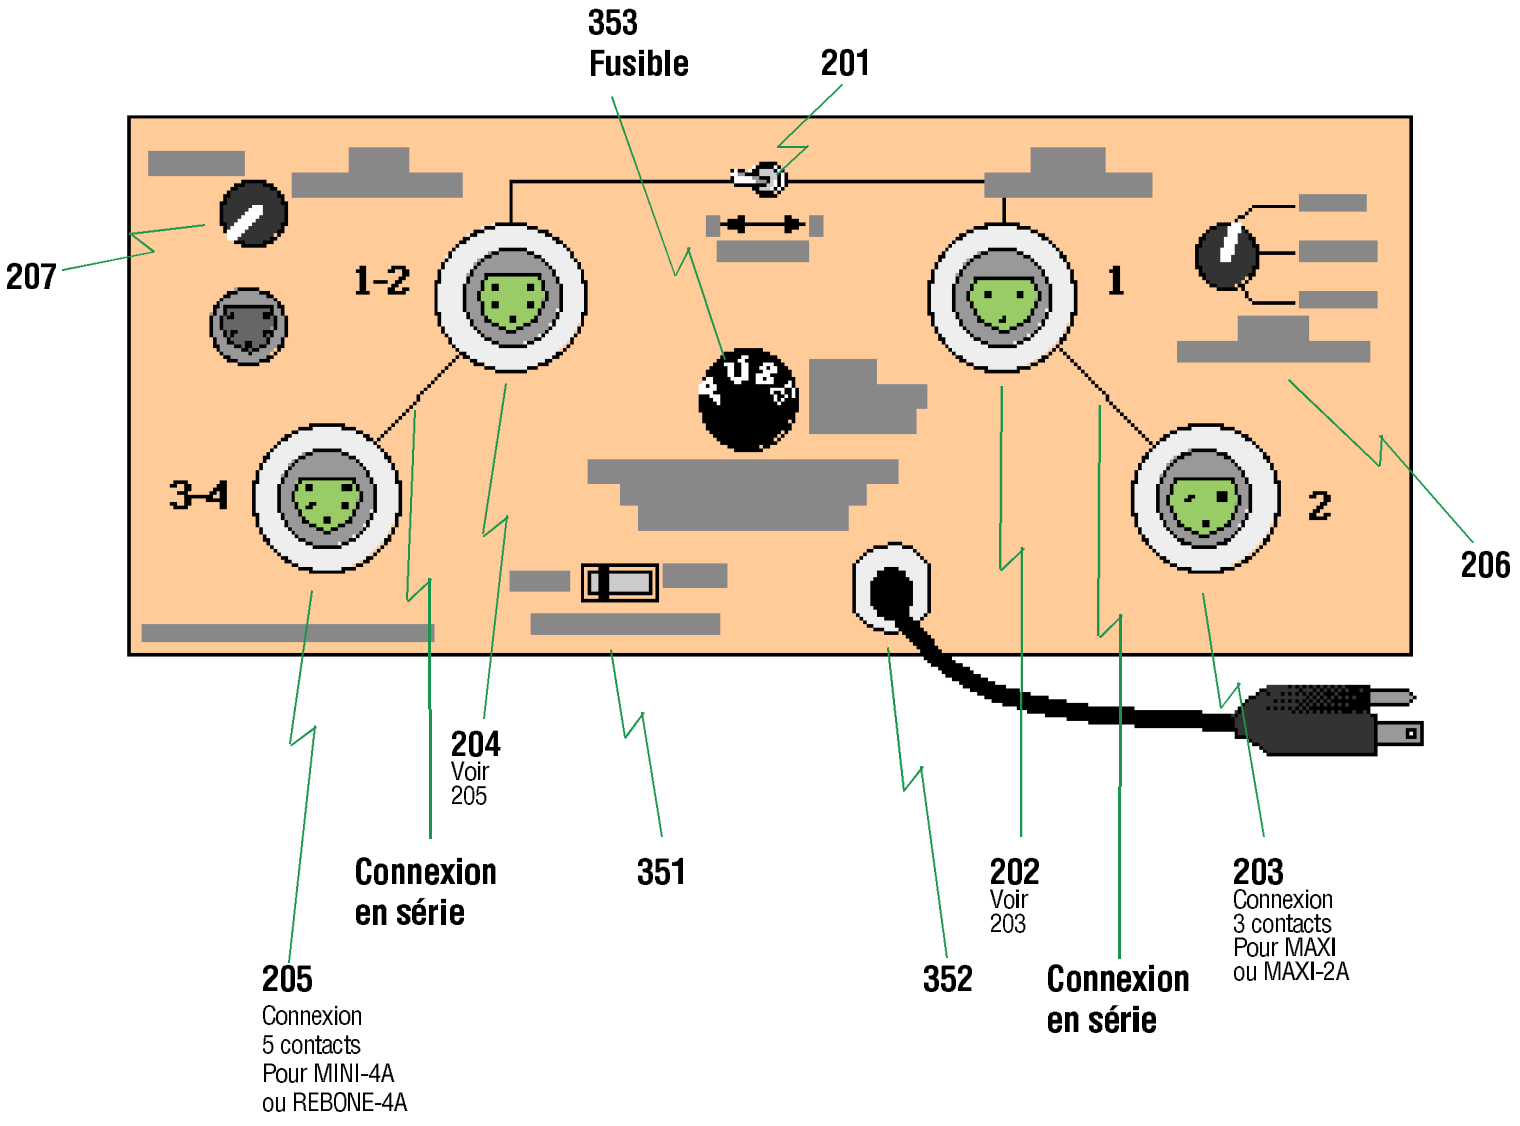

Fig. 4.4 Le Contrôleur RESC™, MBI-3000 *(Panneau arrière)*

4.1 PRÉCAUTIONS et AVIS SUR L'EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ du RESC™

PRÉCAUTIONS

Veuillez lire le présent GUIDE D'EMPLOI et vous assurer que vous comprenez bien les principes de l'application du conditionnement RESC™.

La technique RESC™ peut déranger le sommeil lorsque l'utilisateur est hypersensible au RESC™ et qu'il est conditionné à la tête tard en soirée.

Placez-vous dans une position confortable pendant une session de RESC™ (généralement assis ou couché). Vous n'avez pas à vous déshabiller.

Ne couvrez jamais un applicateur RESC™ avec une couverture ou tout autre tissu isolant. La surchauffe de l'applicateur pourrait en résulter. Il est normal que la température de l'applicateur s'élève très légèrement après une session prolongée à dose élevée.

Le conditionneur RESC™ peut fonctionner continuellement. Cependant, ce n'est pas à conseiller, surtout à dose maximale.

Pour les cinq à dix premières sessions, conditionnez-vous à tous les deux jours si possible.

Les sessions subséquentes peuvent être prises à tous les trois jours ou plus. Lorsque bien toléré, le conditionnement local ou régional (avec les MINI-4A ou les REBONE-4A) peut être pris à tous les jours.

Lorsqu'il s'agit de problèmes chroniques, le sujet ressent parfois les effets positifs seulement après la dixième et parfois même la vingtième session. Souvent, les effets positifs se font sentir dès les premières sessions. Dans de rares cas cependant, 6 à 8 mois de conditionnement sont nécessaires pour connaître une amélioration stable.

L'apparition de symptômes un peu plus aigus, après les deux à quatre premières sessions est normale. C'est la phase initiale d'adaptation au RESC™. Ce n'est pas une raison pour interrompre le conditionnement: une amélioration suit généralement.

Si, après la première, deuxième ou troisième session, une douleur continue se fait sentir dans la région où le conditionnement est appliqué, suspendez alors l'utilisation du conditionneur et voyez un médecin le plus tôt possible, parce qu'une telle réaction est anormale.

Il faut conditionner à faible dose et à distance de l'endroit affecté dans les cas suivants: le syndrome d'embolie artérielle, la claudication intermittente, les angiopathies diabétiques, l'angine de poitrine avec insuffisance coronarienne et le syndrome pré-infarctaire. Évidemment, il s'agit seulement d'induire des effets physiologiques et non de traiter ces problèmes au sens médical du terme.

Avis sur l'efficacité et la sécurité du RESC™:

1. Il n'existe aucune contre-indication absolue du système RESC™ lorsqu'utilisé selon le présent Guide d'Emploi et les directives de MBI ou de l'iRi (l'institut RHUMART® international).

2. Les résultats obtenus depuis 1987 par les propriétaires utilisateurs du conditionneur RESC™ ont démontré la sécurité et l'efficacité de ce système **pour aider** plusieurs cas de:

- port de stimulateur cardiaque (ex.: conditionnement global)
- grossesse avec divers problèmes de santé (ex.: douleurs et problèmes de circulation)
- diabète (ex.: divers problèmes de circulation et de santé en général)
- hémorragie interne (ex.: associée avec les menstruations)
- mycose (champignons, parasites, etc...)
- sclérose en plaques à divers stades
- tumeurs et cancers à divers stades

en induisant seulement des effets physiologiques pour aider ces cas et non en les "traitant" au sens médical.

Plusieurs personnes souffrant des problèmes mentionnés ci-dessus (et des centaines d'autres), ont obtenu une amélioration **en suivant les directives de MBI, celles du présent Guide d'Emploi**, ainsi que celles des Séminaires de Formation sur le RESC™ **offerts par L'institut RHUMART® international** (pour détails concernant des témoignages originaux, voir **l'index-RHUMART®** dans le Journal RHUMART® ou sous couvert séparé).

Précautions et avis… (suite)

3. Pour ce qui est de la **Tuberculose,** on ne nous a encore rapporté aucun cas dans nos archives. Nous invitons donc ceux qui auraient conditionné ou aidé de tels cas à nous les rapporter.

4. Afin de découvrir la gamme quasi illimitée des problèmes de santé résolus, améliorés ou aidés avec le RESC™, vous êtes invités à consulter l'**index-RHUMART®** pour plus de 200 problèmes de santé et les documents VIDÉO originaux des témoignages authentiques correspondants, disponibles de tous les Distributeurs Indépendants des Systèmes RESC™.

5. Pour une information complète concernant **les Bases Scientifiques** de la RHUMART® (ou du conditionnement RESC™), **les résultats** obtenus avec le système AUTO-SANTÉ™ et **"Le Défi de l'an-2000: l'AUTO-SANTÉ™",** le lecteur est invité à se procurer les trois (3) premiers numéros du **Journal RHUMART®** qui sont vendus par les Distributeurs Indépendants du Conditionneur RESC™.

4.2 MBI-3000: MISE EN MARCHE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ

Lorsque vous avez bien lu les précautions d'ordre général qui précèdent, vous êtes prêt à entreprendre l'utilisation pratique du contrôleur RESC™ MBI-3000 avec les applicateurs de votre choix (MAXI, MAXI-2A, MINI-4A ou REBONE-4A), illustrés à la Fig. 4.1.

SUIVEZ DANS L'ORDRE NUMÉRIQUE, LES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES SUIVANTES:

4.2.1 **Vous référant à la figure 4.1, identifiez les applicateurs** dont vous voulez faire l'utilisation afin de vous familiariser avec leurs noms. Un chiffre différent correspond à chaque partie du **contrôleur RESC™ MBI-3000** (Fig. 4.3 et 4.4).

4.2.2 Les figures 4.1 à 4.4 montrent **le coeur du conditionneur RESC™**, soit le **contrôleur MBI-3000**. La Figure 4.3 illustre le panneau avant de l'appareil et la Figure 4.4 en montre le panneau arrière. Vous référant à la Fig. 4.4, branchez **la corde de puissance** (352) dans une prise de courant standard (115 Volts, 60 Hz pour l'Amérique ou 230 Volts, 50 Hz, en Europe). En prenant soin d'utiliser l'adapteur approprié qui vous permet de connecter la corde standard du 115 Volts sur les prises spéciales de 230 Volts, positionnez le **sélecteur d'alimentation** (351) à 115 Volts ou 230 Volts selon le cas.

4.2.3 Faites LE CHOIX de l'APPLICATEUR approprié selon ce qui suit (identifiez les applicateurs Fig. 4.1 et 4.2)

- **La paire de MINI-4A**: pour conditionnement concentré dans une région sphérique d'environ **5cm de diamètre** pour chaque MINI-4A;
- **La paire de REBONE-4A**: pour conditionnement concentré dans une région d'environ **10cm de large par 15cm de long et 10cm de profondeur** par applicateur;
- **Le MAXI**: **cylindre évidé de 50cm de diamètre et de 25cm de haut** utilisé pour conditionnement global au torse, à la ceinture ou aux jambes. Il ne faut pas donner plus d'une session de 10 minutes par jour à un seul endroit avec cet applicateur, à moins que le sujet traité n'ait démontré sa capacité d'absorber plus de conditionnement après au moins un mois d'utilisation;
- **La paire de MAXI-2A**: **anneaux géants de 50cm de diamètre** utilisés pour conditionnement global au torse, à la ceinture et/ou aux deux jambes à la fois. Pour un conditionnement équivalent à celui du MAXI, il suffit de placer les deux anneaux parallèles l'un à l'autre de façon à former un cylindre évidé d'environ 25cm de long tout en respectant la polarité (voir paragraphe 4.2.9).

4.2.4 Positionnement des contrôles du MBI-3000:

Le/les applicateur(s) choisi(s) connecté(s) au **contrôleur MBI-3000 comme l'indique la Fig. 4.1** (les **REBONE-4A** sont connectés aux mêmes endroits que les **MINI-4A** et ils viennent en paire, comme les **MINI-4A**) et **vous référant à la Fig. 4.3**, pressez le bouton de **PUISSANCE (301)**, tournez le bouton d'**AMPLITUDE** (**302**) au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre, la **FRÉQUENCE** (**303**) en position 60 imp/sec. Placez le commutateur sous ce bouton en position 1 (soit à gauche), le bouton **MODULATION** (**304**) en position 2, la durée de session (**305**) à 10 minutes, le commutateur de polarité (**306**) en position **N** , le commutateur (**201,** Fig. 4.4) en position left (**L**) ou right (**R**) selon que vous désirez utiliser les applicateurs connectés à gauche (**L**) ou à droite (**R**) du panneau arrière du MBI-3000 (Fig. 4.4).

A: **Si vous utilisez les applicateurs de droite** (Fig. 4.4), le bouton (**206**) doit être placé en position 1 (.5msec de largeur d'impulsion) avec un applicateur global (MAXI ou paire de MAXI-2A) connecté dans (**202**) et rien de connecté dans (**203**); le bouton (**206**) doit être placé en position 1,2 (.8 msec de largeur d'impulsion), lorsque deux applicateurs MAXI ou 2 paires d'applicateurs globaux (MAXI-2A) sont utilisés à la fois, générant environ 90% de l'intensité produite lorsqu'un seul applicateur MAXI ou une paire d'applicateurs globaux (MAXI-2A) est utilisé.

B: **Lorsque vous utilisez les applicateurs de gauche** (**204**) ou (**205**), Fig. 4.4, le bouton (**308**), Fig. 4.3, agit comme sélecteur des 1, 2, 3 ou 4 applicateurs connectés à l'arrière gauche du générateur; si le sélecteur (**308**) est placé en position 1, un seul applicateur est alimenté; si ce sélecteur est placé en position 1-2, les deux applicateurs connectés sur la sortie (**204**) sont alimentés; si ce sélecteur (**308**) est placé en position 1-3 ou 1-4, alors, trois ou quatre des applicateurs connectés aux sorties (**204**) et (**205**) sont alimentés. La lumière LED (**309**) indique la position du commutateur L - R (**201**), à l'arrière du générateur: la LED est allumée lorsque le commutateur (**201**) envoie le courant dans les applicateurs de gauche (**204** et **205**) et éteinte lorsque ce commutateur envoie le courant dans les applicateurs de droite (**202** et **203**).

4.2.5 **Tournez le bouton de signal sonore (207)**, Fig. 4.4, dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'entendre le signal indiquant que le **conditionnement est en cours.** Pressez ce bouton **(307)** afin de commencer la session.

4.2.6 **Vérifiez si les diodes lumineuses (LED)** au-dessus de chaque bouton de contrôle de la Fig. 4.3 **sont allumées** incluant les bâtonnets lumineux situés au-dessus du bouton **AMPLITUDE** (**302**). Visualisez **les chiffres du chronomètre** au-dessus **du bouton (305)** afin de constater que celui-ci fonctionne bien (décroît de une seconde à la fois, à partir de la durée de session choisie, soit 10 minutes dans le présent test de fonctionnement).

4.2.7 Vérifiez si la **lumière LED incorporée au bouton** (**307**) clignote au même rythme que la **lumière du bouton de MODULATION** (**304**). Si oui, tout est normal et le courant passe dans le(les) applicateur(s) sélectionné(s). Dans le cas contraire, il existe un circuit ouvert. Peut-être que **les boutons** (**206**) ou (**308**) sélectionnent **des applicateurs qui ne sont pas branchés au MBI-3000**. Par exemple, si **le sélecteur** (**308**) est sur 1-3 ou 1-4 et qu'aucun applicateur n'est connecté sur **la prise** (**205**) à l'arrière du contrôleur ou si **le sélecteur** (**206**) est en position 1,2 (.5 msec) ou 1,2 (.8 msec) et qu'aucun applicateur n'est connecté sur **la prise** (**203**), le circuit électrique est ouvert et aucun conditionnement n'est possible.

Si toutes les connexions sont bonnes et que la lumière du bouton (307) n'est pas allumée, vérifiez la présence du champ magnétique près de l'applicateur avec le détecteur de champ MBI-101, ou encore plus simplement, **avec un aimant (ferrite)** fourni avec l'appareil. Tenez l'aimant entre le pouce et l'index, perpendiculairement à la direction du champ magnétique, vous ressentirez de légères vibrations, si vous êtes dans la bonne direction. Dirigez l'aimant vers le centre de l'oreille et "écoutez" le champ magnétique **RHUMART®** en vous approchant de l'applicateur utilisé. **Variez** la position de la **MODULATION** (**304**) et vous entendrez différents "trains" d'impulsions magnétiques. SI RIEN NE SE PRODUIT, RETOURNEZ À L'ÉTAPE 4.2.4.

4.2.8 Le GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ (*Section-V*) illustre le **positionnement des applicateurs** sur différentes parties du corps. (voir les exemples A à Z du positionnement des applicateurs (12 et 13).

4.2.9 **Polarité (N ou S):** De chaque côté (ou à chaque bout) d'un applicateur, **la polarité Nord (N) ou Sud (S)** est indiquée par la lettre N ou S respectivement. **Lorsqu'un seul applicateur est utilisé, la polarité Nord (N) est dirigée vers la région à conditionner, sauf pour le conditionnement physiologique de tous les types de plaies, où la polarité Sud (S) est dirigée vers la plaie (avec le MAXI ou les MAXI-2A, le Nord est dirigé vers la tête de la personne)**; lorsque **deux (2) applicateurs sont utilisés de part et d'autre d'un membre, d'une épaule ou de la tête, le Nord (N) d'un applicateur est orienté d'un côté du membre et le Sud (S) de l'autre applicateur est dirigé de l'autre côté de ce membre**. Ainsi, les champs magnétiques des deux applicateurs s'additionnent. **Pour travailler surtout en surface, on peut placer les deux pôles Nord ou les deux pôles Sud face à face.**

4.3 MBI-3000: PROGRAMMATION ET APPLICATIONS

Maintenant que vous avez étudié les précautions d'ordre général et la procédure de mise en marche et de contrôle de qualité ci-dessus, vous êtes prêt à utiliser le présent Mode d'Emploi simplifié pour sélectionner les paramètres du conditionnement RESC™.

4.3.1 Positionnement des contrôles du générateur MBI-3000 (Fig. 4.3 et 4.4)

(**a**) presser le bouton de **mise en contact** (**301**) (avec la corde de puissance (352) branchée dans la fiche)

(**b**) **la fréquence de base** (**303**) (**PULSE FREQ.**) en position 60 imp/sec. et le commutateur sous ce bouton placé en **position "1"** (soit à gauche);

(**c**) le commutateur de **polarité** (**306**) en position **N**;

(**d**) le **commutateur (201)**, **Fig. 4.4**, en position **L** (pour left) ou **R** (pour right) selon que vous désirez utiliser les applicateurs connectés à gauche ou à droite de l'arrière du **MBI-3000**;

(**e**) placer le **sélecteur d'applicateur**, bouton (**308**) **Fig. 4.3** ou le bouton (**206**) **Fig. 4.4**, en position appropriée (tel que déjà expliqué à la Section 4.2.4.);

(**f**) tourner le bouton de **signal sonore (207) Fig. 4.4** dans le sens des aiguilles d'une montre, afin d'entendre ce signal à l'intensité désirée. La présence du signal sonore indique que le conditionnement est en cours, soit aussitôt que le bouton **START d'initialisation du conditionnement (307) Fig. 4.3** est pressé.

4.3.2 Positionnement des applicateurs

Veuillez vous référer à la *Section-V* pour les exemples A à Z de positionnement des applicateurs globaux (anneaux MAXI-2A) et régionaux (REBONE-4A).

4.3.3 DURÉE d'une session de conditionnement ou MAG. TIME:

Le bouton (305) sert à sélectionner **la durée de la session (T)** comme suit:

T = 10 minutes en général;

T = 5 minutes, pour une première session à la tête ou lors des 2 ou 3 premiers conditionnements **pour induire des effets physiologiques** dans des cas d'ulcères variqueux, par exemple;

T = 15 minutes, pour cas difficiles après 15 jours de conditionnement, lorsque bien toléré par le sujet;

T = 20 à 30 minutes, exceptionnellement, pour certains cas récalcitrants de **bursites d'épaules** et pour certains cas de cancer en phase terminale (c.à.d. **pour induire des effets physiologiques dans ces cas** et non pour les traiter ou les guérir).

4.3.4 AMPLITUDE (A), (302, Fig. 4.3)

A = 1 à 2 pour les **MINI-4A** et les **REBONE-4A; 3 à 5** avec le MAXI ou le MAXI-2A **près du cerveau**; .

A = 1 à 2 avec les **MINI-4A** et les **REBONE-4A; 3 à 6** avec le MAXI ou le MAXI-2A pour induire des effets physiologiques reliés aux **plaies diverses et la circulation sanguine**. Gardez l'AMPLITUDE **A=constante pour au moins 3 sessions consécutives,** si l'utilisateur tolère bien le conditionnement;

A = 2 à 4 avec les **MINI-4A** et les **REBONE-4A**; **6 à 8** avec le MAXI ou le MAXI-2A, pour induire des effets physiologiques afin d'aider **la plupart des cas**. **Gardez A = constante pour au moins trois sessions consécutives** si bien toléré;

A = 4 à 6 avec les **MINI-4A** et les **REBONE-4A** (pour 5 minutes seulement); **10 à 12** avec le MAXI ou le MAXI-2A, pour induire des effets physiologiques **pour les cas difficiles qui ne répondent pas aux plus basses amplitudes** , seulement après 3 ou 4 semaines de conditionnement. Allez-y très graduellement, **gardez A = constante pour au moins trois sessions consécutives**, si bien toléré.

NOTE: Positionner l'extrémité des **MINI-4A à environ 1/2" de la partie conditionnée. Toujours ajouter 1 à la valeur de A suggérée ci-dessus lorsque deux applicateurs (ou paire d'applicateurs) sont "énergisés" simultanément par le MBI-3000** (voir 202, 203, 204 et 205, Fig. 4.4).

4.3.5 MODULATION (304, Fig. 4.3):

Choisissez la modulation **(n)** pour différentes applications comme suit:

n = 0 ou 1: pour aider en cas de **fractures osseuses**, après 2 ou 3 sessions avec n = 2, certains cas réfractaires de **bursite d'épaule** et certains cas de **cancer** en phase terminale (c.à.d. **pour induire des effets physiologiques dans ces cas** et non pour les traiter ou les guérir);

n =2: **pour aider en cas de stress, hypertension, douleur, problèmes inflammatoires, rhumatismes actifs, migraines chroniques, ulcères d'estomac** (4 sessions à n=2 et prendre n=3 par la suite). **Effet sédatif** (assimilation, avec n<3, voir parag. 4.3.6 ci-dessous); (c.à.d. **pour induire seulement des effets physiologiques dans ces cas** et non pour les traiter ou les guérir);

n = 3: **pour aider en cas de mauvaise circulation sanguine, plaies diverses,** brûlures, eczéma, ulcères (débuter avec 4 sessions à **n=2, pour aider les ulcères d'estomac)**, psoriasis, varices, **oedème** (enflures, entorses fraîches), **rhumatismes inactifs. Effet excitant en général** (dissimilation n≥3: voir le parag. 4.3.6 ci-dessous); (c.à d. **pour induire seulement des effets physiologiques dans ces cas** et non pour les traiter ou les guérir);

n = 4: stimulation de la repousse de cheveux avec les effets physiologiques du RESC™.

n = 4 et 5: **à la tête** pour les premières sessions en cas de **migraines chroniques** (avant d'utiliser n=2), **stress** (c.à.d **pour induire des effets physiologiques dans ces cas** et non pour les traiter ou les guérir).

NOTE: Évitez d'utiliser n=3 à la tête, sauf pour améliorer la circulation sanguine ou pour stimuler **la régénération cellulaire en cas de paralysie partielle**. Attendre environ 15 jours après une embolie cérébrale avant d'utiliser le RESC™, (c.à.d. **pour induire des effets physiologiques dans ces cas** et non pour les traiter ou les guérir).

4.3.6 Effets physiologiques sédatif et stimulant:

(sédatif pour **n<3** et stimulant pour **n≥3**)

Les ondes RHUMART® ou RESC™ sont aussi efficaces pour induire les effets physiologiques suivants:

a) un **effet sédatif** associé principalement au processus d'**assimilation** dans la **sympathicotonie**, la **névrose asthénique**, la **neurasthénie**, les **contractures**, l'**arthrose**, la **spondylarthrite**, les **rhumatismes actifs**;

b) un **effet stimulant** associé principalement au processus de **dissimilation** dans la **parasympathicotonie**, la **névrose dépressive**, **l'asthme, les rhumatismes inactifs**.

Une **combinaison des modes sédatif et stimulant** est efficace pour induire des effets physiologiques en cas de **troubles algiques et trophiques des extrémités**, soit avec n=2 pour 5 minutes et n=3 pour 5 minutes, par exemple, (consultez un bon **dictionnaire médical** pour mieux comprendre les problèmes associés à l'assimilation et à la dissimilation).

Le Conditionnement RESC™ induit des effets physiologiques pour aider toutes sortes de problèmes de santé mentionnés au présent GUIDE D'EMPLOI.

4.3.7 **La polarité des applicateurs:**
La polarité (**N** ou **S**) est choisie d'après le paragraphe 4.2.9 ci-dessus. **En résumé**, placez le bouton (**306**) à **N**, et dirigez le pôle nord (**N**) de l'applicateur vers la partie à conditionner, sauf pour les plaies où le pôle sud (**S**) est orienté vers la partie conditionnée. De plus, on peut travailler en surface ou en profondeur selon que les polarités des deux applicateurs utilisés s'opposent (**N** face à **N** ou **S** face à **S**) ou s'entraident (**N** face à **S**).

4.3.8 **Initialisez la session de conditionnement** en pressant le bouton **START** (**307**, Fig. 4.3), après avoir choisi les paramètres (**AMPLITUDE, MODULATION et dURÉE de session).**

4.3.9 **Vérifiez la présence, l'intensité (ou l'AMPLITUDE), la fréquence et la polarité** des impulsions **RHUMART®** en vous servant du **petit aimant** fourni avec l'appareil, ou encore mieux, avec le **Détecteur de Champ RESC™ MBI-101, (18),** offert en option.

NOTE: Il est jugé **essentiel de démontrer la présence des impulsions RHUMART® (ou RESC™) avec l'aimant ou le détecteur MBI-101.** Ceci constitue une prolongation des sens: le **toucher** et l'**ouïe** avec l'aimant, la **vue** avec le **Détecteur de Champ.**

GLOSSAIRE

- assimilation: action d'assimiler
- dissimilation: élimination (déchets)
- sédatif: reposant, relaxant

< : plus petit que
> : plus grand que
≤ : plus petit ou égal
≥ : plus grand ou égal

Section -V-

GUIDE D'EMPLOI
ABRÉGÉ*

du

Conditionneur RESC™

Modèle AUTO-SANTÉ™

* AVIS IMPORTANT: Lorsqu'il y a un doute ou une contradiction apparente ou réelle entre le présent **GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ** (*Section-V*) et la ***Section-IV*** du présent guide, la *Section-IV* doit toujours prévaloir sur le présent GUIDE ABRÉGÉ.

RESC™ est une **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE**™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et **PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE** sont des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc.
et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, **L'institut RHUMART® international (iRi)**, Qc, Canada, janvier 1991.

GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ: Modèle AUTO-SANTÉ™

DÉFINITIONS:

i) Le Modèle AUTO-SANTÉ™ comprend:

un contrôleur RESC™ MBI-3000, (11)

une paire d'anneaux ou cerceaux MAXI-2A, (12)

une paire de REBONE-4A ou applicateurs régionaux, (13)

valise et accessoires

ensemble d'extensions et le présent Guide d'Emploi

ii) Abréviations des paramètres:

Au lieu d'écrire A=2, n=2, T=10 minutes, par exemple, nous utilisons l'abréviation (A2, n2, T10) ou (2-2-10) pour caractériser une session de conditionnement RESC™.

iii) Définition des paramètres du MBI-3000:

∂ **1er bouton à gauche: AMPLITUDE (A)**

A = Intensité du conditionnement ou sa force

∑ **2ème bouton à partir de gauche: FREQUENCY, (f_b, imp/sec)**

f_b = fréquence de base des impulsions
f_b = 60 impulsions par seconde (pour le mode régénérateur)

∏ **3ème bouton à partir de gauche: MODULATION (n)**

n = le mode ou le type de conditionnement.

La MODULATION "n" permet de CHOISIR LE TYPE

π **4ème bouton à partir de gauche: MAG. TIME (T, min)**

T = la durée de la session de conditionnement, en minutes

∫ **POLARITÉ: polarité NORD (N) ou SUD (S)**

N ou S: direction de l'impulsion de champ magnétique.
N: le flux magnétique sort du pôle "N"
S: le flux magnétique retourne par le pôle "S"

5.1 CONDITIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE GLOBAL avec le Contrôleur MBI-3000 et les anneaux MAXI-2A

Avec un anneau (MAXI-2A) placé au torse et l'autre appuyé sur les genoux (la polarité "N" orientée vers la tête du sujet, voir les illustrations A à I de la présente Section), utilisez les paramètres suivants: A5 à A8, n2, T10 à T15 ou (5-8, 2, 10-15) aux deux jours. **Les personnes hypersensibles** qui auraient de la difficulté à s'adapter aux paramètres normaux (A5 à A8) utiliseront A2 à A5, n2, T10 à T15 aux deux jours.

Les "hypersensibles au conditionnement RESC™" sont **souvent des personnes très maigres et/ou âgées (**de plus de 75 ans). Ces individus doivent souvent commencer avec une AMPLITUDE (A) beaucoup plus faible, car le piètre état de conditionnement physique de leurs cellules demande **une période "très douce"** d'adaptation au conditionnement.

Des gens beaucoup plus jeunes peuvent aussi se montrer **"hypersensibles à la présente technique"**. **Cette hypersensibilité indique que l'individu a d'autant plus besoin d'une période de conditionnement prolongée** (au deux jours sur plusieurs mois, par exemple).

CONDITIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE GLOBAL
(avec le MBI-3000 et les anneaux MAXI-2A)

Un Conditionnement global, c'est à partir des épaules en descendant. Ne jamais utiliser les cerceaux (12) au niveau de la tête, sauf avec A≤2 et T≤5 minutes, ou selon la tolérance de l'utilisateur.

On enlève les bijoux et objets ferromagnétiques. On garde les bras joints à l'intérieur de l'applicateur pour fermer le circuit.

Position des cerceaux: Lorsque la personne est à l'intérieur des cerceaux, on s'assure que la polarité Nord (N) est dirigée vers la tête, (**voir les illustrations A à Z sur les pages suivantes.)**

POLARITÉ (N ou S): voir la *Section-IV*, "Programmation et applications" pour choisir la bonne polarité des applicateurs (parag. 4.2.9).

GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ: Modèle AUTO-SANTÉ™

Exemples de positionnement des applicateurs MAXI-2A

A

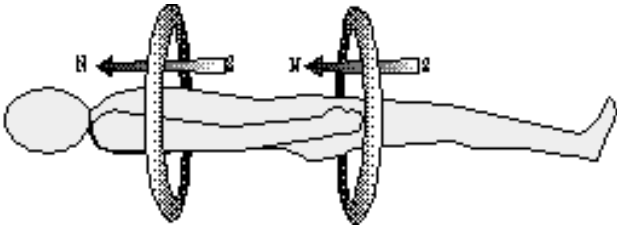

B

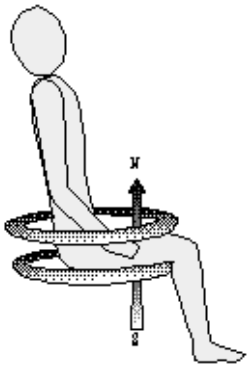

C

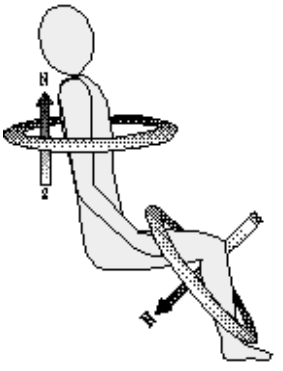

D

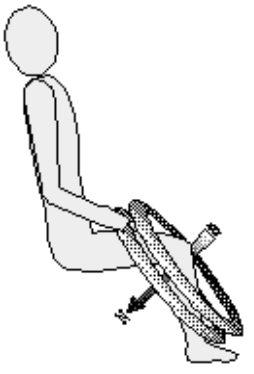

E

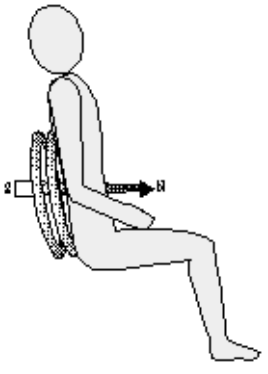

F

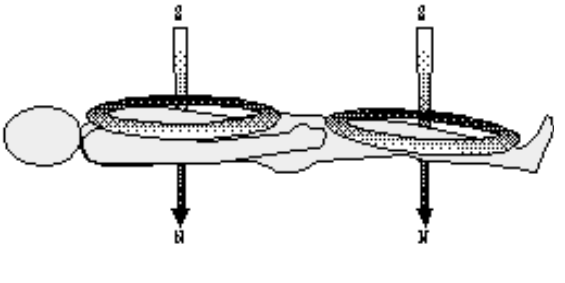

Exemples de positionnement des applicateurs MAXI-2A et REBONE-4A

G1

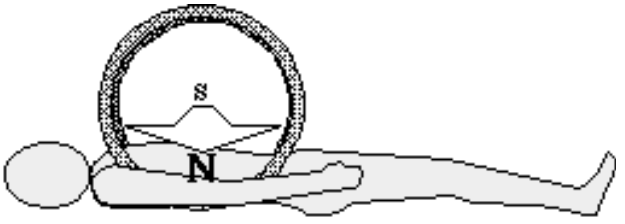

G2



H1

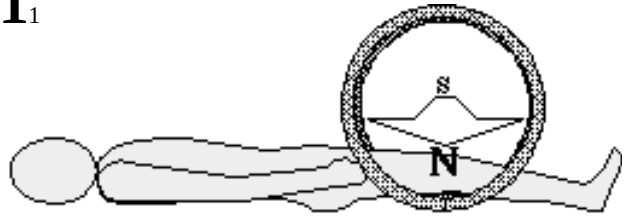

H2



I

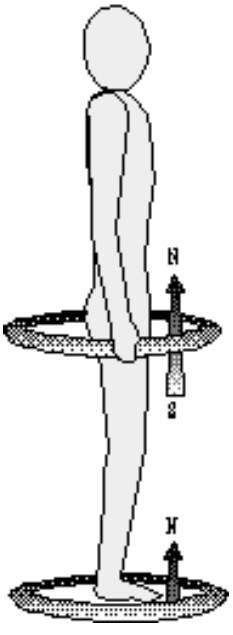

J

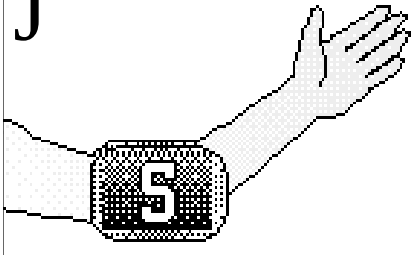

K

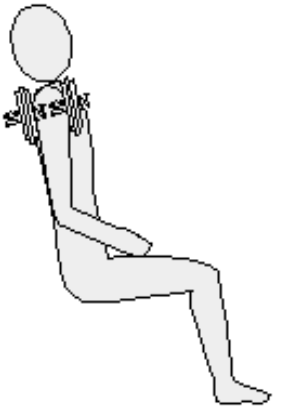

Exemples de positionnement des applicateurs REBONE-4A

L

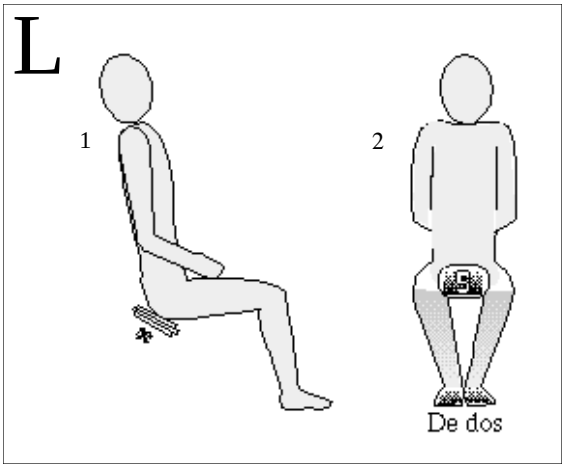

M

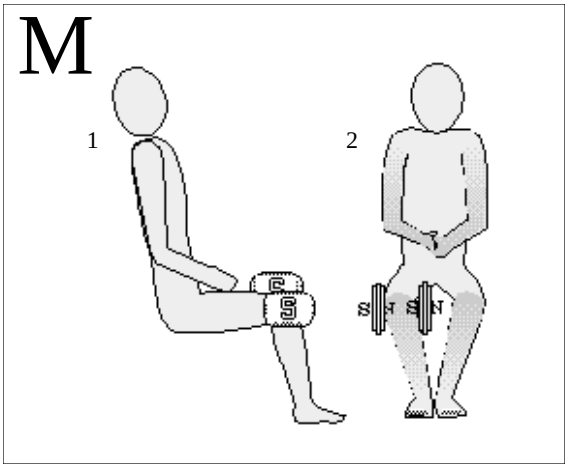

N

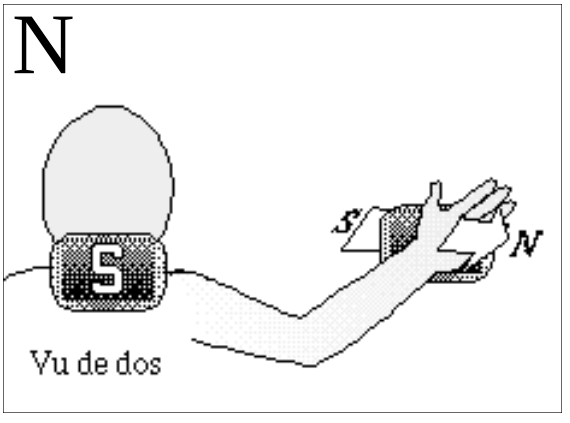

O

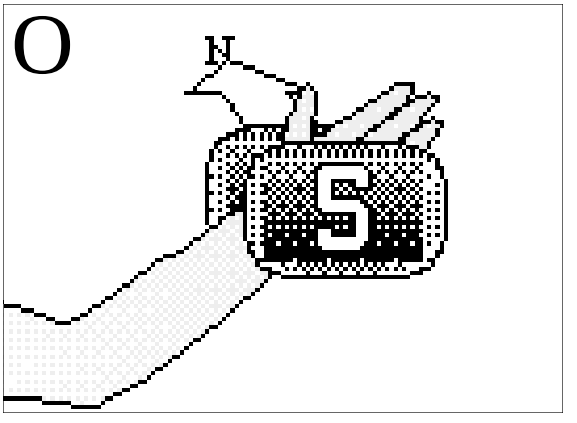

P

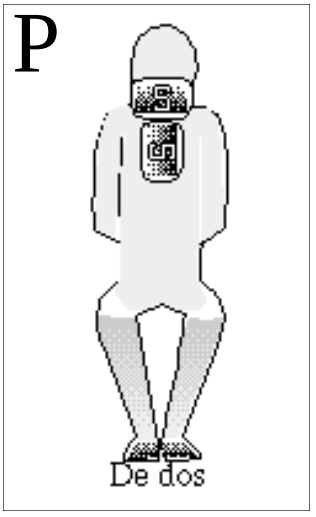

Q

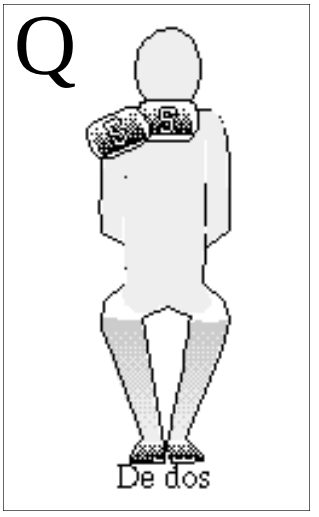

R

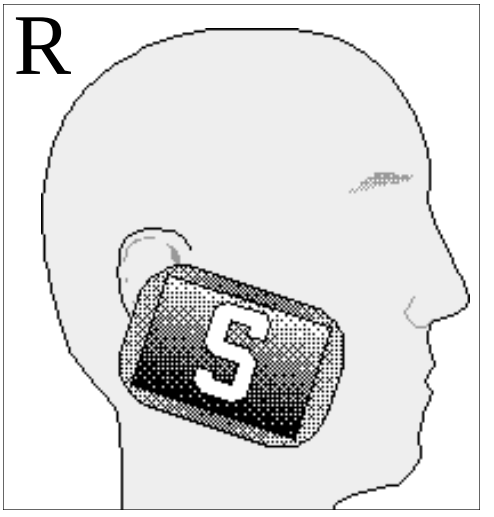

Exemples de positionnement des applicateurs REBONE-4A

S

1

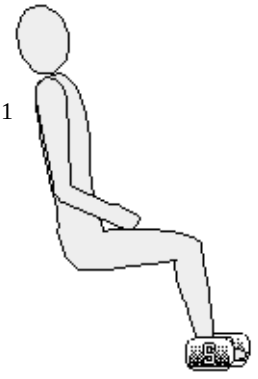

2



T

1

2

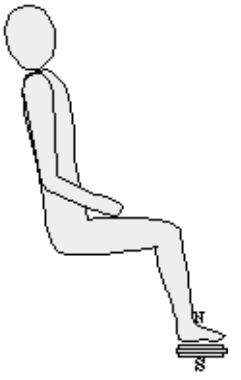

U

1

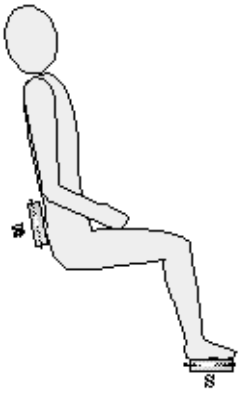

2

De dos

V

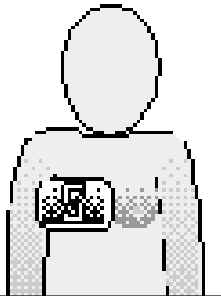

W

1

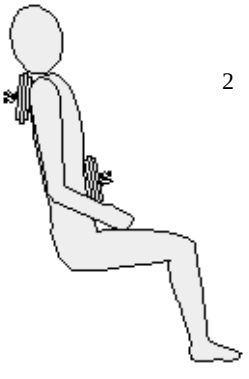

2

X

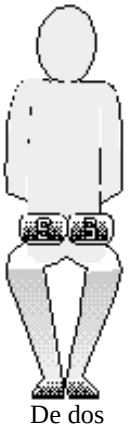

De dos

Y

De dos

Z

SELON
VOTRE
IMAGINATION...

GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ: Modèle AUTO-SANTÉ™

DESCRIPTION DES POSITIONS D'APPLICATEURS

En vous référant aux illustrations A à Z, voici une brève description de ces exemples de positionnement des applicateurs MAXI-2A et REBONE-4A:

A: une paire de MAXI-2A avec la polarité Nord (N) orientée vers la tête, pour le conditionnement RESC™ physiologique global.

B: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) orientée vers la tête, pour le conditionnement du bas du corps et des cuisses (et haut de jambes).

C: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) indiquée par les flèches, pour conditionner les jambes et la région du torse.

D: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) indiquée par la flèche, pour conditionner les jambes avec une grande gamme d'intensité des impulsions RHUMART®.

E: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) indiquée par la flèche, pour conditionner le bas du corps.

F: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) orientée dans le sens des flèches, pour le conditionnement physiologique global.

G_1 et **G_2**: vue de côté (**G_1**) et vue de dessus (**G_2**) d'une paire de MAXI-2A utilisée au niveau du torse, avec la polarité Nord (N) indiquée par les flèches.

H_1 et **H_2**: vue de côté (**H_1**) et vue de dessous (**H_2**) d'une paire de MAXI-2A utilisée pour les deux jambes avec la polarité Nord (N) indiquée par les flèches.

I: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) indiquée par les flèches, pour conditionner le bas des jambes et la partie centrale du corps.

J: une paire de REBONE-4A utilisée sur un coude, avec la polarité Sud (S) telle qu'indiquée.

K: une paire de REBONE-4A utilisée sur une épaule, avec la polarité Nord (N) des applicateurs orientée vers l'avant.

$L_{1,2}$: vue de côté et de l'arrière d'un REBONE-4A utilisé pour la région du coccyx avec la polarité Nord (N) orientée vers la peau.

Description des positions d'applicateurs (suite)

$M_{1,2}$: vue de côté et de l'avant d'une paire de REBONE-4A utilisée sur le genou droit, avec la polarité indiquée par les lettres N et S.

N: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et à la main droite, avec la polarité indiquée par les lettres N et S.

O: une paire de REBONE-4A utilisée des deux côtés de la main droite, avec la polarité Nord indiquée par la flèche et la lettre N.

P: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et au haut du dos, avec la polarité Nord (N) orientée vers le corps.

Q: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et à l'épaule gauche, avec la polarité Nord (N) orientée vers la peau.

R: un REBONE-4A utilisé à la tête, couvrant la partie inférieure de l'oreille droite et la partie arrière des mâchoires de droites, avec la polarité Nord (N) orientée vers la peau.

$S_{1,2}$: vue de côté et vue de face d'une paire de REBONE-4A utilisée des deux côtés du pied et de la cheville droite, avec les polarités N et S indiquées par ces lettres.

$T_{1,2}$: vue de face et vue de côté d'une paire de REBONE-4A utilisée sous les deux pieds (pour la réflexologie), avec la polarité N des deux applicateurs orientée vers le haut.

$U_{1,2}$: vue de côté et vue de dos d'un REBONE-4A utilisé au niveau des reins, avec la polarité N orientée vers la peau.

V: un REBONE-4A utilisé sur le sein droit, avec la polarité Nord (N) orientée vers le corps.

$W_{1,2}$: vue de côté et vue de face d'une paire de REBONE-4A utilisée sur la nuque et le côté droit de l'abdomen, avec la polarité N orientée vers le corps.

X et **Y**: vue de face d'une paire de REBONE-4A placés horizontalement ou verticalement sur la partie inférieure du dos, avec la polarité N orientée vers le corps.

Z: différentes positions, polarités et orientations des applicateurs selon votre imagination et la partie du corps que vous désirez conditionner.

5.2 CONDITIONNEMENT RÉGIONAL avec les applicateurs "REBONE-4A"

On utilise les REBONE-4A pour des endroits précis au **niveau de la tête** ou **du corps** avec la MODULATION (n) selon les effets physiologiques désirés. Voir la Section 5.4 ci-dessous pour le choix de la MODULATION (n).

a) Niveau de la tête ou au-dessus des épaules

Utilisez A1 à A2, T5 à T10, aux 2 jours: débutez avec (A1, n2, T5) pour 5 à 6 sessions et ensuite utilisez (A1, n3, T5) pour stimuler la régénération cellulaire, si désiré.

b) Niveau du corps (avec le "n" selon l'effet physiologique recherché)

Utilisez A2 à A3 pour 10 minutes, aux 2 jours ou A5 à A6 pour 5 minutes, aux 2 jours.

c) Polarité

Toujours placer la polarité NORD (N) face à la partie à conditionner sauf pour les brûlures et les plaies ouvertes, où on utilise la polarité SUD (S) face à la plaie.

Important: La polarité NORD (N) est plutôt "**calmante**" alors que la polarité SUD (S) est plutôt "**stimulante**" lors de la cicatrisation des plaies par exemple.

d) Réflexologie physiologique RESC™

Utilisez les **REBONE-4A sous les pieds,** la polarité NORD face au-dessous du pied, car c'est à cet endroit que sont placés les "**points de commande**" de réflexologie du corps entier.

Pour la réflexologie RESC™ avec un REBONE-4A sous chaque pied, essayez les paramètres (A2,n2,T10) aux deux jours pour 4 à 5 sessions; par la suite, augmentez à (A3 ou A4, n2, T10) si vous pouvez le prendre. Au début, utilisez A ≤ 2 pour une meilleure adaptation au conditionnement.

5.3 MODE DE CONDITIONNEMENT RESC™ COMBINÉ: GLOBAL (avec les cerceaux) et RÉGIONAL (avec les REBONE-4A)

Il est excellent d'alterner les sessions "**globales**" et "**régionales**" de conditionnement, soit une journée avec les cerceaux (**MAXI-2A)** pour le conditionnement global et l'autre journée avec les REBONE-4A pour le conditionnement local ou régional.

Essayez-le!

5.4 LE CHOIX de la MODULATION (n) ou de L'EFFET PHYSIOLOGIQUE PRÉDOMINANT

n = MODULATION = choix de l'effet prédominant

a) Effets "n2": (ou effet anti-stress prédominant)

Par exemple, avec "n2" nous pouvons obtenir en priorité un ou plusieurs des effets physiologiques suivants:

- **RELAXANT et/ou**
- **ANTI-DOULEUR et/ou**
- **ANTI-INFLAMMATOIRE**

b) Exemples d'applications des effets "n2":

Effet "n2" RELAXANT: pour les gens aux prises avec le stress relié à l'hypertension et à une mauvaise oxygénation des cellules.

Effet "n2" ANTI-DOULEUR: pour les gens victimes de stress relié aux bursites, entorses, rhumatismes, différents types d'arthrite, etc...

Effet "n2" ANTI-INFLAMMATOIRE: l'effet physiologique anti-inflammatoire relié aux problèmes musculo-squelettiques, arthritiques et rhumatismaux peut être induit avec la MODULATION "n2".

Souvenez-vous que les effets du RESC™ ne sont pas spécifiques à une maladie ou à un problème de santé. Ces effets physiologiques renforcent le système naturel d'autodéfense et de guérison de l'homme.

c) Effets "n3" (ou effet stimulant prédominant):

Avec la MODULATION "n3", nous obtenons les effets physiologiques prédominants suivants (deux effets physiologiques de base):

- **Stimulation de la RÉGÉNÉRATION** de tous les types de cellules
- **Stimulation de la CIRCULATION sanguine**

IMPORTANT: avant de passer à "n3", dans les cas de douleurs, nous devons contrôler cette dernière avec l'effet "n2"; ensuite, pour 5 à 6 sessions de conditionnement, nous alternons entre 5 minutes à n3 (n3, T5) et 5 minutes à n2 (n2, T5). Par la suite, nous pouvons y aller avec la MODULATION "n3" seulement, et augmenter l'AMPLITUDE (A) lentement à chaque 3 ou 4 sessions, selon notre tolérance au conditionnement RESC™.

Dans les cas de problèmes de **circulation sanguine,** prenez 2 à 4 sessions avec (A5, n2, T10, global) avant de passer à "n3": **le corps doit d'abord être relaxé globalement pour améliorer la performance et l'endurance du système cardiovasculaire.**

d) Effets "n4" et "n5":

Les MODULATIONS "n4" et "n5" peuvent induire des effets physiologiques bénéfiques pour les personnes atteintes de:

- migraines chroniques
- problèmes viscéraux
- problèmes glandulaires
- hypotension (n3 et n4) et (n2 pour l'hypertension)
- perte de cheveux (n4)

Débutez avec "n5" en utilisant les anneaux ou les REBONE-4A pour induire des effets physiologiques aidant à résoudre les problèmes glandulaires et viscéraux; après 5 à 6 sessions, vous pourrez passer à "n4".

Exceptions:

Pour les **migraines** provoquées par le **stress**, commencez par trois séances de conditionnement global avec "n2" au lieu de "n5".

Pour induire des effets physiologiques chez les gens atteints de problèmes de pelade (perte de cheveux, sourcils, etc...) utilisez d'abord (A1, n4, T10) pour 3 à 4 sessions hebdomadaires et ensuite, essayez (A2, n4, T10) aux deux jours, si vous tolérez bien le conditionnement RESC™.

e) **Les effets "n6", "n7", "n8" et"n9"** sont utilisés principalement avec le mode Super-TENS. Ce mode d'utilisation est hors de la portée du présent GUIDE et sera décrit dans des publications futures.

5.5 LA CLÉ DU SUCCÈS avec votre conditionneur RESC™

Relisez souvent

votre

GUIDE D'EMPLOI

pour le
Conditionnement RESC™

en particulier la Section 4.3 intitulée: **"MBI-3000, Programmation et applications"**. Notez consciencieusement les PARAMÈTRES (A, n, T) (Amplitude, Modulation, Durée) que vous utilisez afin d'améliorer **vos performances physiques et psychiques à court et à long terme.**

Ainsi, vous serez plus heureux et en santé avec le RESC™, PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE$_{TM}$ de la Vie.

SOYEZ CONFIANT
et
PERSÉVÉRANT

car vous méritez de réussir !

Souvenez-vous aussi que c'est **votre responsabilité**
d'adapter les paramètres de conditionnement RESC™
à vos besoins spécifiques.

Votre santé ,

c'est votre vie et votre liberté

et vous seul y tenez autant !

Devenez-en donc le maître
et aidez-nous à propager le message RHUMART®
à tous les peuples de la terre.

Je termine sur ce voeu du plus profond de mon âme!

Pour la

Physique RHUMART®

et les **bases scientifiques** du

Conditionnement RESC™,

voir le

Journal RHUMART®
disponible de tous
les Distributeurs Indépendants
des **Systèmes RESC™**

En Français: depuis novembre 1990
En anglais: printemps 1991

FIN DU GUIDE ABRÉGÉ

Section -VI-

Spécifications techniques et énergétiques

du Conditionneur RESC™

6. MBI-3000: Spécifications techniques et énergétiques

6.1 Définition simplifiée de la MODULATION (n)

C'est la fonction de bloquer ou d'éliminer une série d'impulsions à l'intérieur du train d'impulsions de base, f_b, (dont le **nombre d'impulsions** régulières, consécutives et équidistantes dans le temps est déterminé par la position du bouton PULSE FREQ. et du diviseur de fréquence {1, ÷10}). Par exemple, si le diviseur de fréquence est en position 1 et le bouton PULSE FREQ. est en position 60 imp./sec, le conditionneur RESC™ crée une série régulière de 60 impulsions **RHUMART®** à la seconde.

Les chiffres de 1 à 9 et la position CONT. (continue) placés autour du bouton de MODULATION signifient ce qui suit:

n=CONT.:	aucune impulsion du train d'impulsions de base n'est bloquée et la stimulation est régulière.				
n=1:	1	impulsion	sur 2	est	bloquée;
n=2:	2	impulsions	consécutives	sur 4	sont bloquées;
n=3:	4	"	"	sur 8	"
n=4:	8	"	"	sur 16	"
n=5:	16	"	"	sur 32	"
n=6:	32	"	"	sur 64	"
n=7:	64	"	"	sur 128	"
n=8:	128	"	"	sur 256	"
n=9:	256	"	"	sur 512	"

En général, pour tout entier positif **n**, il y a 2 à l'exposant **(n-1)**, (qui s'écrit $\mathbf{2^{n-1}}$) impulsions consécutives sur $\mathbf{2^n}$ impulsions du train d'impulsions régulières qui sont bloquées par la fonction du bouton **MODULATION** (ou **n-MODULATION**).

6.2 Visualisation des trains d'impulsions:

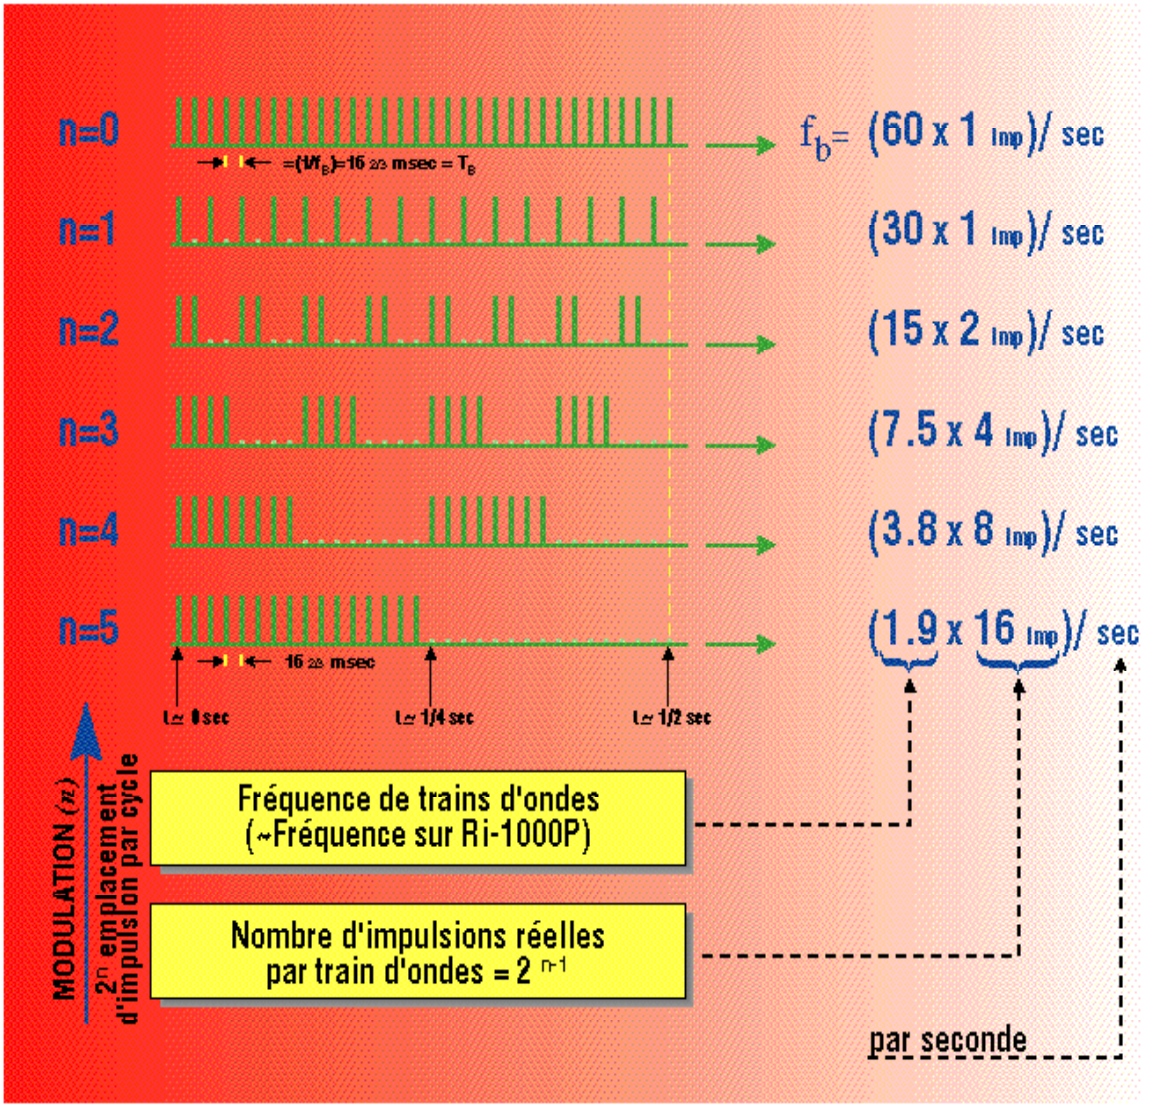

Fig. 6.1: Illustration des trains d'impulsions pour différentes valeurs de **n**, avec une fréquence de base, f_b, égale à 60 impulsions par seconde.

PUISSANCE D'ALIMENTATION ET FLUX D'ÉNERGIE ABSORBÉE PAR LE SUJET (en $\mu W/cm^2$)

(a) puissance d'alimentation du MBI-3000

$P = VI \cong 115 \times 0.5 = 57.5$ watts

(b) flux d'énergie absorbée par le sujet avec le MAXI et le MBI-3000

$$P_{abs} \leq \frac{P_{MAXI}}{2} = \frac{L_{MAXI}\, i^2_{max}}{4}$$

$$P_{abs} \leq \frac{(2 \times 10^{-3}) \times (6.37)^2}{4} \cong 20 \ \frac{mW}{MAXI} \ \textbf{(crête)}$$

En prenant la surface du **MAXI** comme égale à $(\pi r^2) = \pi \times 25^2 = 625\ \pi\ cm^2$, nous pouvons calculer le flux de puissance (crête) absorbée par le sujet par cm^2, soit:

$$\mathbf{20}\ \frac{\mathbf{mW}}{\mathbf{MAXI}} \ \mathbf{x}\ \frac{\mathbf{MAXI}}{\mathbf{625\ \pi\ cm^2}} \cong \mathbf{10}\ \frac{\mu W}{cm^2}$$

donc **$P_{abs} \leq 10\ \mu W/cm^2$ (crête)**;

ou encore **10/13.2 $\cong$ 0.75 $\mu W/cm^2$** de puissance moyenne absorbée, et ce pour la MODULATION **n=0.**

Pour **$n \geq 1$**, la puissance crête est la même que pour n=0, soit:

$P_{abs} \leq 10\ \mu W/cm^2$ (crête);

mais la puissance moyenne absorbée est égale à **0.37 $\mu W/cm^2$** (pour **$n \geq 1$).**

La valeur de puissance crête absorbée calculée ci-dessus avec la formule

$$P_{abs} \leq \frac{L i^2_{max}}{4}$$

est en accord avec la puissance crête réellement absorbée telle que mesurée lors de l'expérience "**main-à-main**", pour un adulte placé dans un **MAXI** connecté au générateur **MBI-3000.**

MBI-3000: Spécifications techniques (suite)

Dans l'expérience "main à main", nous avons:

$$\mathbf{P_{absorbée}} \leq \left\{ \frac{\mathbf{k_{\in}\, i_{max}}}{\mathbf{S_{bras}}} \right\}$$

où i_{max} est le courant maximal induit dans les bras et S_{bras} est la surface moyenne de section d'un bras.

Nous avons mesuré, pour l'amplitude maximale du MBI-3000, les valeurs suivantes:

$\mathbf{k_{\in}} \cong \mathbf{0.5\ Volt}$ [valeur initiale de $\in(t)$]
$\mathbf{i_{max}} \cong \mathbf{1\ mA}$ (avec une résistance négligeable connectant les deux mains ensemble dans le MAXI).

Sachant que la surface de section (cross section) d'un bras (au niveau du poignet) est d'environ **50 cm²**, nous avons pu calculer la valeur expérimentale de la puissance crête absorbée comme suit:

$$\mathbf{P_{abs}} \leq \left(\frac{\mathbf{0.5\ Volt \times 1\ mA}}{\mathbf{50\ cm^2}} \right) = \mathbf{10\mu W/cm^2,}\ \text{(crête)}$$

$$\mathbf{P_{abs}} \leq \mathbf{10\mu W/cm^2,}\ \text{(valeur crête)}$$

(c) transmission d'énergie au sujet (MBI-3000)

Avec les valeurs calculées en (a) et (b) ci-dessus pour la **puissance d'alimentation** et la **puissance absorbée** par le sujet, nous avons:

$$\%\ \text{transmission} \leq \frac{\mathbf{20\ mW}}{\mathbf{57.5W}}\ \text{(crête)} = \mathbf{0.035\%}\ \text{(crête)}$$

NOTE:

Nous pourrions également calculer **la puissance absorbée** par le sujet avec les autres applicateurs, le calcul étant semblable à celui du **MAXI**. Nous arriverions à des puissances du même ordre de grandeur pour les **MAXI-2A** que pour le **MAXI**. Pour les applicateurs **JAM-8A, les REBONE-4A et les MINI-4A**, nous arriverions à des densités d'énergie absorbée de plus en plus grandes, car l'énergie est de plus en plus concentrée par ces applicateurs. En conséquence, si nous voulons la plus grande densité d'énergie dans une petite région du sujet traité, nous devons choisir **la paire de MINI-4A** comme applicateurs.

(d) Alimentation du MBI-3000 sur batteries:

Le **MBI-3000** peut fonctionner sur batteries. En effet, il suffit de fournir une alimentation continue (D.C.) d'environ 110 à 115 Volts (± 5%) avec une ou plusieurs batteries connectées en série. Ceci peut être pratique pour opérer les systèmes **RHUMART®** en Afrique par exemple où souvent il n'y a pas d'alimentation électrique stable.

e) L'alimentation du contrôleur RESC™ MBI-3000 peut provenir d'une petite génératrice électrique à gazoline. En effet, MBI vend des petites génératrices légères et efficaces pour alimenter le MBI-3000, même dans le désert.

Annexe - A

CLASSIFICATION non-médicale du Conditionneur RESC™

Nous tenons à vous rappeler que **le Conditionneur RESC™ n'est en aucune façon un appareil médical** et encore moins un appareil de diagnostic ou de traitement d'une maladie ou d'un problème de santé en particulier. **En fait, cette technique ne s'adresse même pas à la maladie mais bien au stress physiologique relié à la plupart des problèmes de santé.**

C'est un appareil de Conditionnement physique que l'on pourrait qualifier de "**subtil**" pour les systèmes biologiques parce qu'**aucune contraction cellulaire ou musculaire n'est visible à l'oeil nu** avec cette technique et ce, même si cette méthode réussit à induire les **trois (3) effets physiologiques fondamentaux**. Ceux-ci aident à rétablir la santé et l'équilibre de l'être humain même dans des cas où toutes les méthodes antérieures, fussent-elles "douces", médicales et/ou paramédicales, ont échoué.

C'est ce qu'ont constaté de nombreux propriétaires du Système RESC™, antérieurement connu sous le nom de "Système AUTO-SANTÉ™ RHUMART®". Nous référons le lecteur à l'**index-RHUMART®** et au **Journal RHUMART®** pour les fondements scientifiques et les résultats obtenus par les **propriétaires-utilisateurs** de ce système révolutionnaire de conditionnement physique cellulaire.

Plusieurs autres raisons fondamentales viennent appuyer **notre décision de classer le Conditionneur RESC™ dans la catégorie des appareils scientifiques d'expérimentation destinés à aider** tout individu qui désire **améliorer sa santé et son bien-être** ou ceux de sa famille immédiate.

Annexe - A (suite)

CLASSIFICATION non-médicale

Voici quelques-unes de ces raisons:

1. Le **Conditionneur RESC™** est très sécuritaire et efficace lorsqu'utilisé selon le présent **GUIDE D'EMPLOI.**

2. Pour obtenir les meilleurs résultats avec cette technique, le choix des paramètres (Amplitude, Modulation et Durée de session) doit demeurer entre les mains du propriétaire-utilisateur qui est le mieux placé pour ressentir les **3 effets physiologiques RESC™** et adapter les paramètres à ses propres besoins selon la **Méthode Scientifique Expérimentale** élémentaire décrite à la *Section-III* du présent GUIDE.

3. Le niveau d'énergie absorbée par l'utilisateur du Conditionneur RESC™ est inférieur à la limite sécuritaire suggérée par le "**Bureau of Radiological Safety**" des Etats-Unis dans un document intitulé "Guidelines for the Evaluation of Electromagnetic Risk for trials of Clinical NMR Systems" (**Résonance Magnétique Nucléaire)**; soit, par exemple, que la dérivée mathématique du champ magnétique par rapport au temps ($\frac{dB}{dt}$) pour exposition partielle ou totale du corps soit inférieure à **3 Tesla/seconde** ce qui est équivalent à **15 gauss/0.5 msec**. Cette limite est suggérée pour des procédures de diagnostic qui peuvent durer de **20 minutes à une heure** alors qu'en général, une session de Conditionnement RESC™ ne dure que 5 à 10 minutes.

Puisque le champ RHUMART® utilisé lors du Conditionnement RESC™ est en général inférieur à 15 gauss, pour un temps de montée des impulsions de champ magnétique RHUMART® de 0.5 msec, nous pouvons conclure que:

*le **Conditionnement RESC™** est plus sécuritaire que les procédures utilisées pour le diagnostic avec les systèmes de Résonance Magnétique Nucléaire dont se servent plusieurs hôpitaux.*

* Référence: Bioelectromagnetic Society Newsletter, Avril 1982, No 29 (P.O. Box 3651, Arlington, VA, 22203, USA)

4. Nous pouvons affirmer que **le conditionnement RESC™ n'est pas plus médical que la marche ou l'exercice physique car tous les effets physiologiques RESC™ sont également induits par la marche régulière ou l'exercice physique effectué lors d'un programme de conditionnement physique standard.** Mais pourquoi avons-nous besoin du **Conditionneur RESC™** si l'exercice physique produit à peu près les mêmes effets? La réponse est évidente pour tous ceux qui souffrent **d'arthrite et de divers problèmes chroniques de santé**: ces problèmes ont minimisé leur volonté et leur capacité physique de faire **l'exercice minimum essentiel au maintien** du bon fonctionnement de leur système musculo-squelettique et éventuellement, la capacité de réparation et de régénération de leurs cellules endommagées.

5. Par ses trois effets physiologiques, cette technique **renforce les mécanismes d'autodéfense et de guérison de l'organisme humain** ou sa capacité générale à combattre **n'importe quel problème de santé ou "maladie"**, un peu comme une nutrition adéquate et de bonnes habitudes de conditionnement physique (et mental) améliorent et renforcent tous les mécanismes de défense et de guérison de l'organisme **sans que LA NUTRITION et/ou L'EXERCICE PHYSIQUE ne soient considérés pour autant comme un "traitement" médical.**

Pourquoi avons-nous tant insisté sur la **classification non-médicale du RESC™ ?**

Annexe - A (suite)

CLASSIFICATION non-médicale

En bref, pour les raisons fondamentales suivantes:

1. Le contrôle ou le choix des paramètres du conditionnement RESC™ doit rester entre les mains des propriétaires-utilisateurs afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Ceci a été démontré par de nombreuses personnes atteintes de problèmes chroniques et qui n'avaient obtenu que peu ou pas de résultats avec le Conditionneur RESC™ utilisé dans le contexte d'une clinique de médecine officielle et/ou "douce". Par la suite, la plupart de ces gens ont réussi à se prendre en main en devenant propriétaires du Conditionneur RESC™ et en suivant les programmes de formation nécessaires à son utilisation judicieuse.

2. Si nous décidions de classer le Conditionneur RESC™ comme un appareil médical, **le risque serait très grand pour que, tôt ou tard, la profession médicale veuille prescrire les paramètres du Conditionnement RESC™** et ainsi priver l'utilisateur de son jugement pour mieux adapter les paramètres à ses propres besoins, à un moment donné de sa vie. Pire encore, la profession médicale pourrait tenter de décider qui aura le droit de posséder son Conditionneur RESC™, ce que nous considérons comme le droit fondamental de toute personne faisant partie d'une société libre et démocratique.

3. Le Conditionnement RESC™ utilise des impulsions bioélectriques très similaires à celles du système nerveux, soit aux impulsions de courant de l'ion calcium (Ca^{++}) qui sont absolument essentielles à la transmission de l'influx nerveux dans tout le corps humain. C'est pourquoi **le Conditionnement RESC™ est parfaitement physiologique et représente un complément naturel à l'exercice physique.**

4. Le Conditionneur RESC™ ne s'adresse pas à la maladie mais plutôt au STRESS physiologique relié à la plupart des problèmes de santé (Voir l'article intitulé "L'Anti-Stress-RHUMART®" dans le Journal RHUMART®, Vol. 1, No 1, mars 1990).

Annexe-B

Les 3 "faux-problèmes"

les plus fréquemment rapportés par les propriétaires du Conditionneur RESC™

Je reçois souvent des appels de personnes qui croient que leur système est défectueux alors qu'il s'agit **de vérifier avec eux le positionnement des sélecteurs pour s'apercevoir que quelqu'un a tout simplement déplacé un bouton.** Je vous donne ici les 3 cas les plus fréquents de "faux-problèmes" de fonctionnement.

1. À la fréquence 0 imp/sec., il ne se donne pas de conditionnement. Cette fonction est disponible **pour expérimenter l'effet Placebo** que peut avoir le système sur une personne alors qu'en réalité le chronomètre peut fonctionner mais qu'il n'y a pas de conditionnement

Attention: Si on allume le système alors que la fréquence est à 0 imp/sec., il peut arriver que la fusible saute. Ne jamais laisser le bouton PULSE FREQ. à 0 imp/sec. lorsqu'on éteint l'appareil.

2. Avec **les extensions de 12 pieds** et les applicateurs locaux, toujours s'assurer que **le bouton "LEFT APPL. SELECTOR"** sur le devant de l'appareil soit à la position "1-2" ou "1-4" si l'on veut avoir un conditionnement.

3. Avec **un set d'applicateurs globaux**, il faut se brancher à la position 1 sur les sorties "RIGHT APPLICATORS" et il est essentiel que le sélecteur "RIGHT APP. SELECTOR" soit à la position **"1 (.5 ms)"**.

Espérant le tout à votre entière satisfaction,

ÉLECTRONIQUE SEM inc.

Denis Carrier
Directeur général

Annexe-C

Garantie du Manufacturier

et ses conditions d'application

Le vendeur garantit que l'instrument et le matériel vendus sont de bonne qualité et cette garantie sera effective pour douze (12) mois à compter de la date de la livraison, après quoi elle cessera automatiquement de s'appliquer.

Cette garantie ne s'appliquera pas, et elle sera nulle et de nul effet, si l'instrument et le matériel vendus n'ont pas été utilisés conformément aux instructions fournies et en respectant le mode d'emploi (voir la NOTE-A) dans tous ses détails, ou encore si les pertes ou dommages, de quelque nature que ce soit, éventuellement subis résultent de la négligence, de l'imprudence, de l'abus, du mauvais usage, du vol, d'un accident, ou de la faute dans l'entretien et l'opération de l'instrument et du matériel vendu.

L'acheteur s'engage à prévenir par écrit sans délai le vendeur pour tout bris ou toute défectuosité survenue ou constatée pendant le temps de garantie, sinon cette garantie ne pourra aucunement s'appliquer et le vendeur sera entièrement libéré de toute responsabilité. Il y aura également exonération de responsabilité et non-application de la garantie dans tous les cas où une personne autre qu'un agent de service autorisé par le fabricant aura tenté, de quelque façon que ce soit, de modifier, réparer, ajuster ou autrement manipuler l'instrument et le matériel vendus, à moins que ce ne soit fait conformément aux instructions et au mode d'emploi fournis.

La garantie du vendeur ne s'appliquera qu'aux instruments et au matériel fabriqués par lui; quand aux instruments et au matériel fabriqués par un fabricant autre que le vendeur, c'est uniquement la garantie de ce fabricant qui s'appliquera, le vendeur pouvant aider l'acheteur à faire valoir cette garantie.

NOTE-A:
Utilisation de l'instrument et du matériel vendus

L'acheteur s'engage à utiliser l'instrument et le matériel vendus suivant les instructions et le mode d'emploi fournis par le vendeur et le fabricant si le vendeur n'est pas le fabricant.

En aucun cas l'acheteur ne devra tenter de modifier, de fabriquer une copie, un spécimen, un modèle ou toute autre forme de réplique de l'instrument et du matériel vendus, ni permettre qu'une telle tentative soit faite par des tiers.

NOTE-B:
Frais de transport

Pendant toute la durée de la garantie, les frais de transport aller et retour sont à la charge de l'acheteur.

NOTE-C:
Garantie prolongée

Une garantie prolongée de 5 ans est disponible chez le manufacturier, et ceci aux frais de l'acheteur.

Pour toute information de la part du manufacturier,
adressez-vous par écrit à :

[redacted]
(agent du manufacturier)
[redacted]
Québec, (Qc), Canada, G1V 4C5

ou à votre **Distributeur Indépendant**